www.3z.pl

KATALOG PRODUKTÓW IMPLANTOLOGICZNYCH

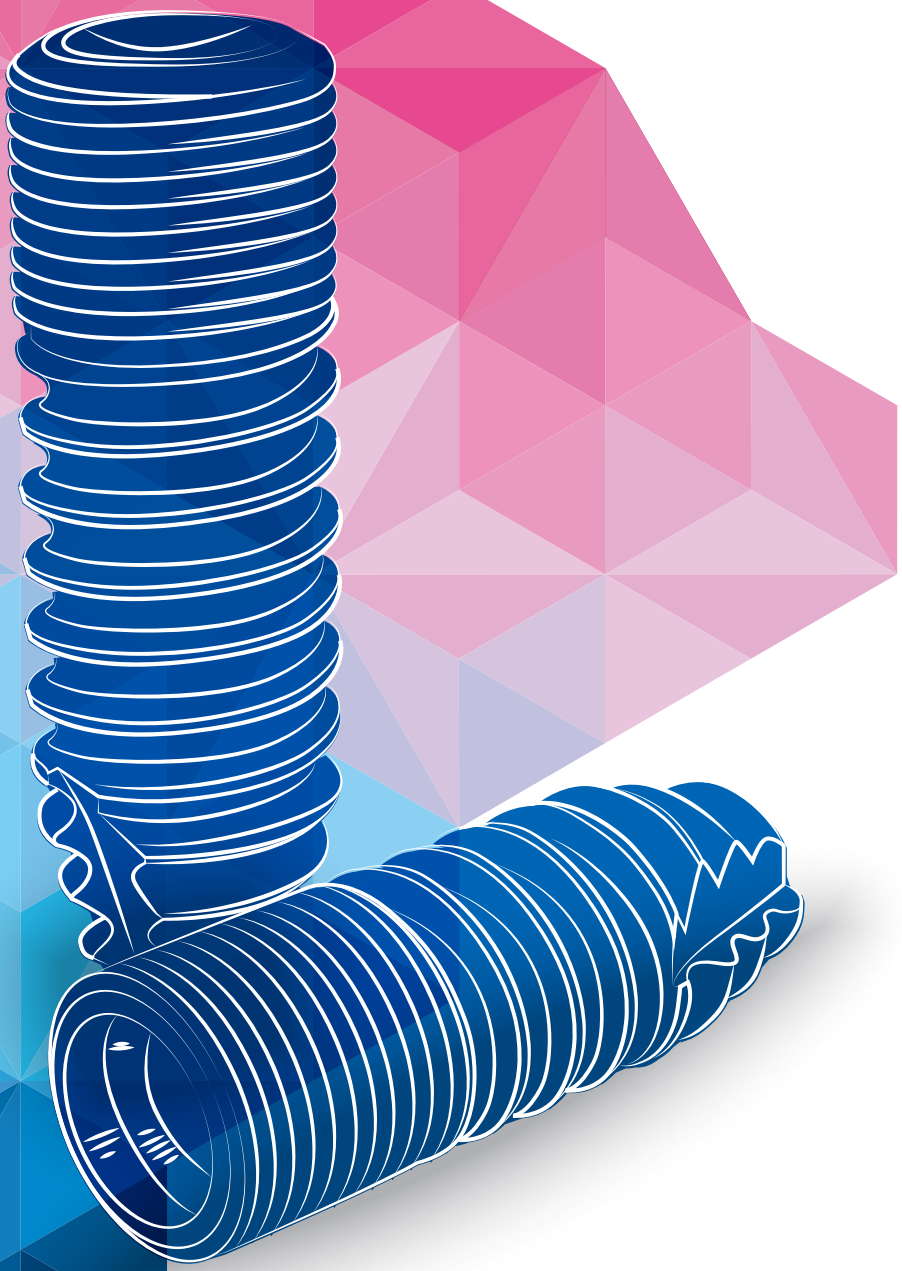

Das FAIRE Premium Implantat-System ICX

Wyjaśnienie nazw, znaków i etykiet

LOT — Numer serii

REF — Numer artykułu

STERILE R — Sterylizowany promieniami gamma

Data ważności

Do jednorazowego użytku

Przeczytaj dokładnie instrukcję

Nie sterylizuj ponownie

Nie używaj jeśli opakowanie jest naruszone

CE Produkty ICX® są oznaczone znakiem CE i spełniają wymagania dyrektywy medycznej 93/42 EWG

Znaczenie koloru kodowania wierteł i implantów oraz uwagi

Biały	= Ø 2,9 mm mini	Czerwony	= Ø 3,75 mm
Różowy	= Ø 3,3 mm Narrow	Zielony	= Ø 4,1 mm
Żółty	= Ø 3,45 mm plus	Niebieski	= Ø 4,8 mm

Skróty wymiarów:

L = Długość całkowita
H = Wysokość całkowita mierzona od platformy implantu
GH = Wysokość dziąsła
Hex = rozmiar sześciokąta
B = Szerokość
T = Głębokość
K = Wysokość protetyczna (od granicy preparacji)
Ø = Średnica

Made in Germany & Swiss

Kolorowe ilustracje i rozmiary zdjęć w tym katalogu są jedynie poglądowe i nie są wiążące!
Wszystkie informacje i instrukcje są dostępne na naszej stronie icx.com.pl
W razie potrzeby prosimy o kontakt mailowy bądź telefoniczny.

zamówienia: +48 32 767 55 66 lub sklep.3z.pl

ICX-ACTIVE LIQUID

Nr artykułu	Implant
LAC-330080	ICX-Active Liquid **Ø 3,3 mm x 8 mm**
LAC-330100	ICX-Active Liquid **Ø 3,3 mm x 10 mm**
LAC-330125	ICX-Active Liquid **Ø 3,3 mm x 12,5 mm**
LAC-390080	ICX-Active Liquid **Ø 3,75 mm x 8 mm**
LAC-390100	ICX-Active Liquid **Ø 3,75 mm x 10 mm**
LAC-390125	ICX-Active Liquid **Ø 3,75 mm x 12,5 mm**
LAC-390150	ICX-Active Liquid **Ø 3,75 mm x 15 mm**
LAC-425080	ICX-Active Liquid **Ø 4,1 mm x 8 mm**
LAC-425100	ICX-Active Liquid **Ø 4,1 mm x 10 mm**
LAC-425125	ICX-Active Liquid **Ø 4,1 mm x 12,5 mm**
LAC-425150	ICX-Active Liquid **Ø 4,1 mm x 15 mm**
LAC-480080	ICX-Active Liquid **Ø 4,8 mm x 8 mm**
LAC-480100	ICX-Active Liquid **Ø 4,8 mm x 10 mm**
LAC-480125	ICX-Active Liquid **Ø 4,8 mm x 12,5 mm**
LAC-480150	ICX-Active Liquid **Ø 4,8 mm x 15 mm**

Nowy!

CECHY I ZALETY:

Hydrofilowa i mikrostrukturyzowana powierzchnia implantu.

Zoptymalizowane ukształtowanie powierzchni styku kości z implantem

Skrócony czas gojenia

Pewniejsze natychmiastowe obciążenie

Implant ICX-MINI Ø 2,9 mm

ICX–*mini* implant biały, Ø 2,9 mm

Nr artykułu

C-001-290080	ICX-*mini* Ø 2,9 x 8 mm
C-001-290100	ICX-*mini* Ø 2,9 x 10 mm
C-001-290125	ICX-*mini* Ø 2,9 x 12,5 mm

Uwaga: Używać wyłącznie śruby zamykającej C-003-000004 do ICX–*mini* !



Klucze protetyczne dla implantów ICX-mini

Nr artykułu		Artykuł
C-015-100006		Przenośnik implantu
C-015-100009		Klucz kontrowy do trzymania implantu przy wykręcaniu kulki
C-015-100007		Klucz do wymiany kulki
960002		Klucz 0,9 do śruby zamykającej ICX-mini oraz wymiany wkładki matrycy t-ecco

Rozwiązania protetyczne dla implantów ICX-mini

Nr artykułu		Artykuł	Wymiary	Materiał
C-003-000004		Śruba zamykająca ICX-mini *używać klucza Hex 0,9 mm	Ø 2,9 mm	Tytan
C-022-090001		ICX-t-bona łącznik kulowy ICX-mini, 1 mm *	1 mm GH	Tytan
C-022-090002		ICX-t-bona łącznik kulowy ICX-mini, 2 mm	2 mm GH	Tytan
C-022-090003		ICX-t-bona łącznik kulowy ICX-mini, 3 mm	3 mm GH	Tytan
C-026-010501		Łącznik ICX-mini do cementowania (Łącznik może zostać zacementowany na kulce i w razie potrzeby oszlifowany. Tak przygotowany łącznik stanowi podstawę do odbudowy pojedynczej korony. Wycisk należy pobierać jak z poziomu oszlifowanego zęba)	5 mm Ø 7 mm K	Tytan
C-031-030001		Łącznik ICX-Maximus dla ICX-mini **	3 mm GH	Tytan

*jest to standardowy łącznik kulowy otrzymywany w zestawie z implantem Ø 2,9 mm. Łącznik można wymieć na inny ICX-mini o większej wysokości dziąsłowej lub zastosować łącznik typu lokator lub zacementować na nim czapeczkę tytanową C-026-010501.

** Dwuczęściowy łącznik ICX Maximus jest dalszym udoskonaleniem firmy medentis medical i jest kompatybilny z matrycami LOCATOR ™.

zamówienia: +48 32 767 55 66 lub sklep.3z.pl

Implant ICX-Narrow Ø 3,3 mm

W obszarach o ograniczonej przestrzeni wąskie implanty dentystyczne oferują wyraźne zalety. Wynika to z opracowania innowacyjnych typów implantów o zmniejszonej średnicy, które pozwalają spełnić minimalne kryteria prawidłowej implantacji.

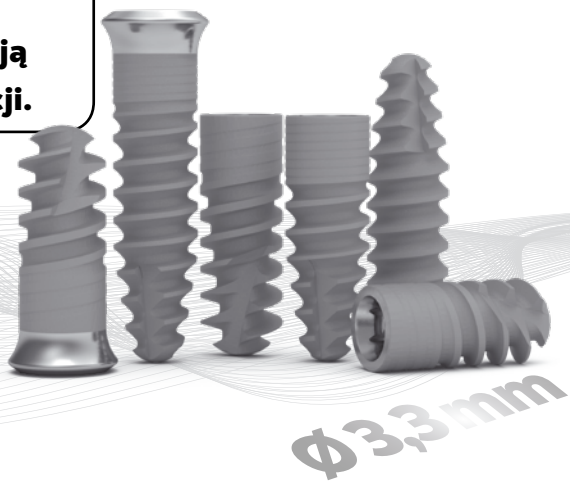

Znakomite cechy implantów ICX-NARROW Ø 3,3 mm

Wąskie implanty ICX-PREMIUM i wąskie implanty ICX-ACTIVE-MASTER o średnicy 3,3 mm otwierają całkowicie nowe horyzonty w dziedzinie implantacji o zmniejszonej średnicy!



Naszym celem było dać Ci implant, który można stosować w obszarach o bardzo ograniczonej przestrzeni bez konieczności rezygnacji ze stabilności.

Rozszerzamy naszą rodzinę ICX o implant o zmniejszonej średnicy. Może to obejmować dodatkowe wskazania w zwykłej wysokiej jakości i precyzji typowego dla ICX połączenia implant-łącznik.
Aby to zagwarantować, przeprojektowaliśmy je z myślą o wąskiej średnicy i stworzyliśmy zupełnie nową linię protetyczną.



Teraz możesz łatwiej rozwiązywać nawet trudne przypadki i polegać na naszych wąskich implantach ICX-PREMIUM oraz wąskich implantach ICX-ACTIVE-MASTER o średnicy jedynie 3,3 mm !

WAŻNA UWAGA:

Implanty ICX-PREMIUM NARROW BONE LEVEL (BL) i TISSUE LEVEL (TL) oraz

ICX-ACTIVE-MASTER-NARROW BONE LEVEL (BL) i TISSUE LEVEL (TL)

***NIE MOGĄ** być wyposażane w standardowe elementy systemu ICX!*

Ze względu na inną geometrię wewnętrzną niż standardowa linia
Ø 3,75 mm (czerwona) · Ø 4,1 mm (zielona) · Ø 4,8 mm (niebieska)

Implanty Ø 3,3 mm mają własną linię protetyczną (różowa kolorystyka) !

Więcej informacji o ICX-Narrow znajdziesz w dedykowanym tej platformie katalogu ICX. Obok znajdziesz link do naszego działu „do pobrania”.

Implant ICX-PREMIUM BONE LEVEL

UWAGA

Przy zamawianiu łączników protetycznych z niskim profilem wyłaniania GH 0 mm:

Implanty ICX-TISSUE LEVEL (TL) mają inną platformę niż implanty ICX-Bone Level (BL) !

Ze względu na kształt kołnierza te najniższe łączniki są dedykowane dla BL lub TL i nie są zamienne jak reszta elementów systemu.

Zwracamy ponadto uwagę na dedykowany analog do implantów Tissue Level (odzwierciedlający kołnierz a więc też inną wysokość) !

ICX–PREMIUM **(BL)** implant **czerwony, Ø 3,75 mm**

Nr artykułu

C-001-390080	ICX Ø 3,75 x 8 mm
C-001-390100	ICX Ø 3,75 x 10 mm
C-001-390125	ICX Ø 3,75 x 12,5 mm
C-001-390150	ICX Ø 3,75 x 15 mm

ICX–PREMIUM **(BL)** implant **zielony, Ø 4,1 mm**

Nr artykułu

C-001-425080	ICX Ø 4,1 x 8 mm
C-001-425100	ICX Ø 4,1 x 10 mm
C-001-425125	ICX Ø 4,1 x 12,5 mm
C-001-425150	ICX Ø 4,1 x 15 mm

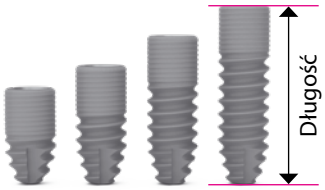

ICX–PREMIUM **(BL)** implant **niebieski, Ø 4,8 mm**

Nr artykułu

C-001-480080	ICX Ø 4,8 x 8 mm
C-001-480100	ICX Ø 4,8 x 10 mm
C-001-480125	ICX Ø 4,8 x 12,5 mm
C-001-480150	ICX Ø 4,8 x 15 mm

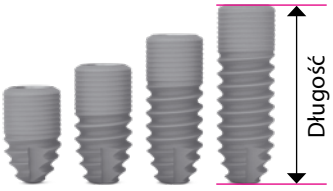

Implant ICX-PREMIUM TISSUE LEVEL

GERMAN & SWISS MADE

ICX DAS FAIRE PREMIUM IMPLANTAT-SYSTEM.

ICX–plus (implant wyłącznie w wersji tissue level) żółty, Ø 3,45 mm

Nr artykułu

C-001-345065	ICX-*plus* Ø 3,45 x 6,5 mm
C-001-345080	ICX-*plus* Ø 3,45 x 8 mm
C-001-345100	ICX-*plus* Ø 3,45 x 10 mm
C-001-345125	ICX-*plus* Ø 3,45 x 12,5 mm

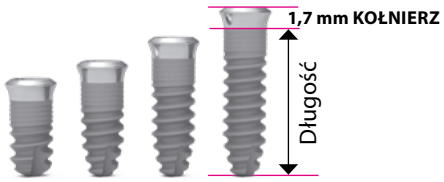

ICX–PREMIUM TISSUE LEVEL **(TL)** Implant czerwony, Ø 3,75 mm

Nr artykułu

T-001-375080	ICX Premium TissueLine Ø 3,75 x 8 mm
T-001-375100	ICX Premium TissueLine Ø 3,75 x 10 mm
T-001-375125	ICX Premium TissueLine Ø 3,75 x 12,5 mm

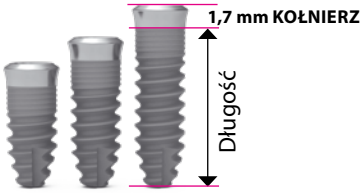

ICX–PREMIUM TISSUE LEVEL **(TL)** Implant zielony, Ø 4,1 mm

Nr artykułu

T-001-425080	ICX Premium TissueLine Ø 4,1 x 8 mm
T-001-425100	ICX Premium TissueLine Ø 4,1 x 10 mm
T-001-425125	ICX Premium TissueLine Ø 4,1 x 12,5 mm

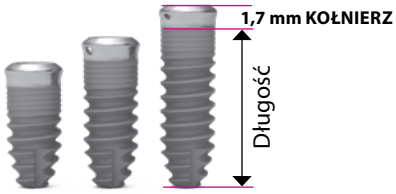

ICX–PREMIUM TISSUE LEVEL **(TL)** implant niebieski, Ø 4,8 mm

Nr artykułu

T-001-480049	ICX Premium TissueLine Ø 4,8 x 4,9 mm
T-001-480065	ICX Premium TissueLine Ø 4,8 x 6,5 mm
T-001-480080	ICX Premium TissueLine Ø 4,8 x 8 mm
T-001-480100	ICX Premium TissueLine Ø 4,8 x 10 mm
T-001-480125	ICX Premium TissueLine Ø 4,8 x 12,5 mm

Wiertła ICX-PREMIUM

Nr artykułu	Kaseta chirurgiczna ICX-PREMIUM
C-018-010003	

UWAGA! **WAŻNA UWAGA!** UWAGA!

W przypadku wierteł ICX-PREMIUM, a także naszych wierteł ICX-ACTIVE-MASTER, długość wiertła jest o 0,3 mm dłuższa ze względu na końcówkę wiertła - należy upewnić się, że ta dodatkowa długość jest dopuszczalna podczas pracy w obszarze ważnych struktur anatomicznych .

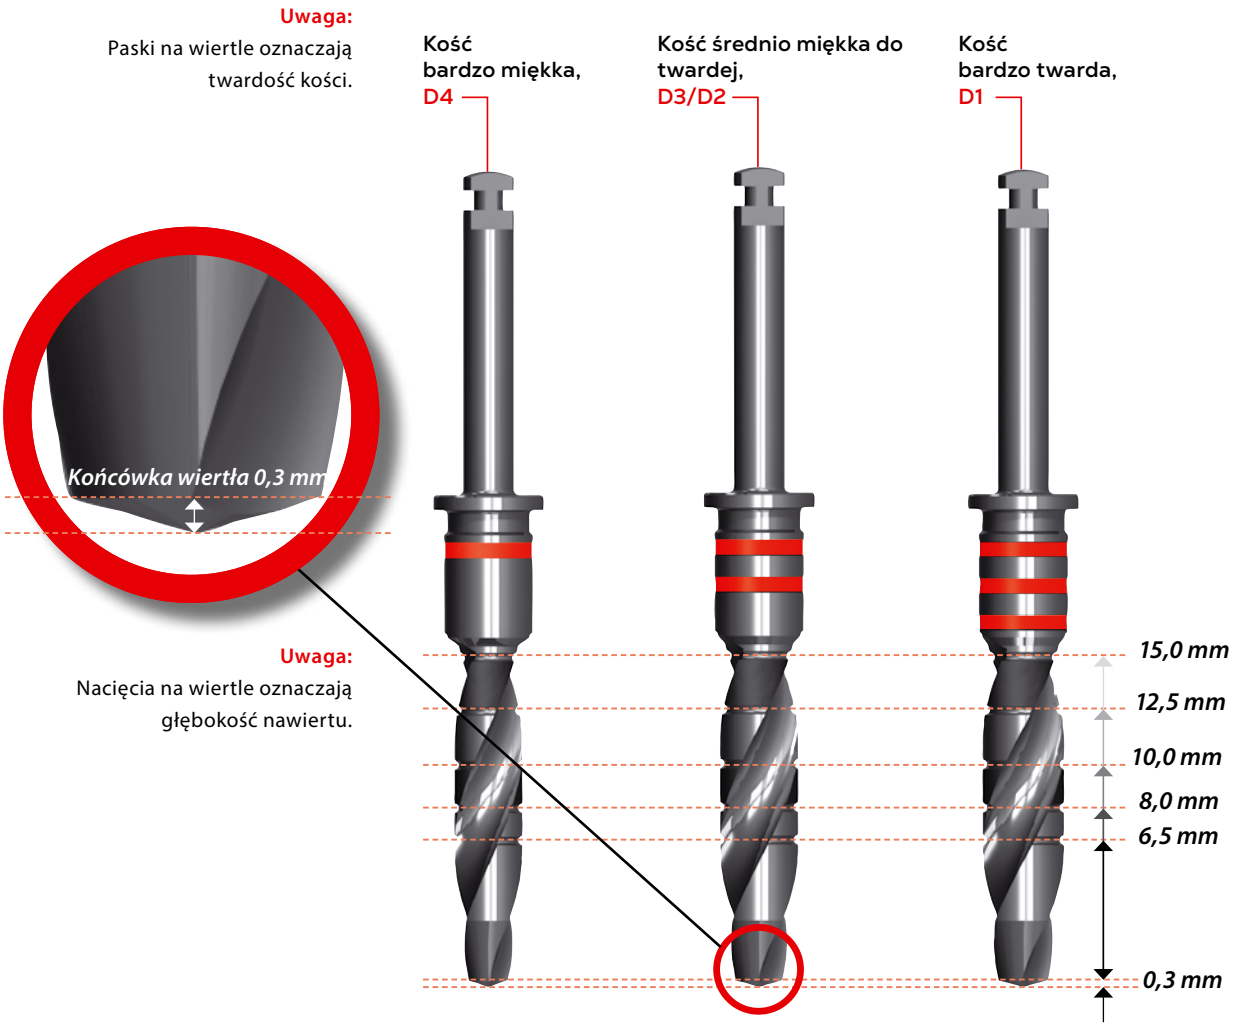

Układ wierteł kasety chirurgicznej

Nr artykułu	Wiertło	Artykuł
FIL-186RF		Wiertło pilotujące
C-014-006290		Wiertło ICX białe II Ø 2,9 mm D3/D2
C-014-007290		Wiertło ICX białe III Ø 2,9 mm D1
C-014-003345		Wiertło ICX-plus żółte I Ø 3,45 mm D4
C-014-006345		Wiertło ICX-plus żółte II Ø 3,45 mm D3/D2
C-014-007345		Wiertło ICX-plus żółte III Ø 3,45 mm D1
C-014-003375		Wiertło ICX czerwone I Ø 3,75 mm D4
C-014-006375		Wiertło ICX czerwone II Ø 3,75 mm D3/D2
C-014-007375		Wiertło ICX czerwone III Ø 3,75 mm D1
C-014-003410		Wiertło ICX zielone I Ø 4,1 mm D4
C-014-006410		Wiertło ICX zielone II Ø 4,1 mm D3/D2
C-014-007410		Wiertło ICX zielone III Ø 4,1 mm D1
C-014-003480		Wiertło ICX niebieskie I Ø 4,8 mm D4
C-014-006480		Wiertło ICX niebieskie II Ø 4,8 mm D3/D2
C-014-007480		Wiertło ICX niebieskie III Ø 4,8 mm D1
C-014-005345		Wiertło kortykalne żółte Ø 3,45 mm
C-014-005375		Wiertło kortykalne czerwone Ø 3,75 mm
C-014-005410		Wiertło kortykalne zielone Ø 4,1 mm
C-014-005480		Wiertło kortykalne niebieskie Ø 4,8 mm
C-014-000003		Frez do plastyki wyrostka ICX-Crestotom

Zalecana prędkość obrotowa podczas nawiercania: ok 400 obr./min. + intensywne chłodzenie.

Implanty ICX-ACTIVE MASTER BONE LEVEL

Zalecany moment obrotowy podczas implantacji: od 15 do 55 Ncm (max 40 Ncm w obszarze międzybródkowym)
Zalecana prędkość obrotowa podczas implantacji: do 15 obr./min.

UWAGA

Przy zamawianiu łączników protetycznych z niskim profilem wyłaniania GH 0 mm:

Implanty ICX-TISSUE LEVEL (TL) mają inną platformę niż implanty ICX-Bone Level (BL) !

Ze względu na kształt kołnierza te najniższe łączniki są dedykowane dla BL lub TL i nie są zamienne jak reszta elementów systemu.

Zwracamy ponadto uwagę na dedykowany analog do implantów Tissue Level (odzwierciedlający kołnierz a więc też inną wysokość) patrz str.10 !

ICX–ACTIVE-MASTER implant **czerwony, Ø 3,75 mm**

Nr artykułu

ACM-001-390080	ICX-Active Master Ø 3,75 x 8 mm
ACM-001-390100	ICX-Active Master Ø 3,75 x 10 mm
ACM-001-390125	ICX-Active Master Ø 3,75 x 12,5 mm
ACM-001-390150	ICX-Active Master Ø 3,75 x 15 mm

ICX–ACTIVE-MASTER implant **zielony, Ø 4,1 mm**

Nr artykułu

ACM-001-425080	ICX-Active Master Ø 4,1 x 8 mm
ACM-001-425100	ICX-Active Master Ø 4,1 x 10 mm
ACM-001-425125	ICX-Active Master Ø 4,1 x 12,5 mm
ACM-001-425150	ICX-Active Master Ø 4,1 x 15 mm

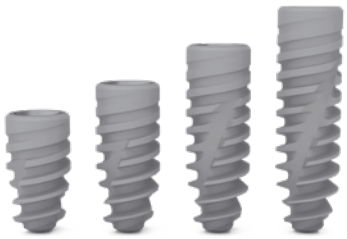

ICX–ACTIVE-MASTER implant **niebieski, Ø 4,8 mm**

Nr artykułu

ACM-001-480080	ICX-Active Master Ø 4,8 x 8 mm
ACM-001-480100	ICX-Active Master Ø 4,8 x 10 mm
ACM-001-480125	ICX-Active Master Ø 4,8 x 12,5 mm
ACM-001-480150	ICX-Active Master Ø 4,8 x 15 mm

Implanty ICX-ACTIVE MASTER TISSUE LEVEL

ICX–ACTIVE MASTER TISSUE LEVEL implant **czerwony, Ø 3,75 mm**

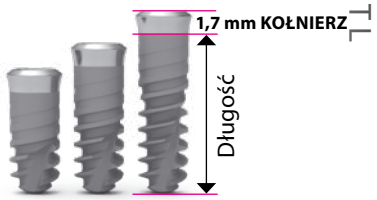

Nr artykułu

TAM-001-375080	ICX Active Master TissueLine Ø 3,75 x 8 mm
TAM-001-375100	ICX Active Master TissueLine Ø 3,75 x 10 mm
TAM-001-375125	ICX Active Master TissueLine Ø 3,75 x 12,5 mm

ICX–ACTIVE MASTER TISSUE LEVEL implant **zielony, Ø 4,1 mm**

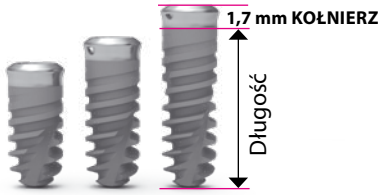

Nr artykułu

TAM-001-425080	ICX Active Master TissueLine Ø 4,1 x 8 mm
TAM-001-425100	ICX Active Master TissueLine Ø 4,1 x 10 mm
TAM-001-425125	ICX Active Master TissueLine Ø 4,1 x 12,5 mm

ICX–ACTIVE MASTER TISSUE LEVEL implant **niebieski, Ø 4,8 mm**

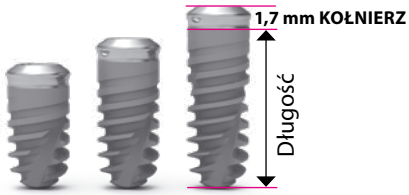

Nr artykułu

TAM-001-480080	ICX Active Master TissueLine Ø 4,8 x 8 mm
TAM-001-480100	ICX Active Master TissueLine Ø 4,8 x 10 mm
TAM-001-480125	ICX Active Master TissueLine Ø 4,8 x 12,5 mm

ICX-ACTIVE-WHITE Implanty cyrkonowe

Zalecany moment obrotowy podczas implantacji: od 15 do 35 Ncm.
Zalecana prędkość obrotowa podczas implantacji: 15 obr./min.

Nr artykułu

AW-002-425080	ICX-ACTIVE WHITE implant Ø 4,1 x 8 mm jednoczęściowy, **GH 2.5 mm**, K 4,5 mm
AW-002-425100	ICX-ACTIVE WHITE implant Ø 4,1 x 10 mm jednoczęściowy, **GH 2.5 mm**, K 4,5 mm
AW-002-425125	ICX-ACTIVE WHITE implant Ø 4,1 x 12,5 mm jednoczęściowy, **GH 2.5 mm**, K 4,5 mm
AW-002-425150	ICX-ACTIVE WHITE implant Ø 4,1 x 15 mm jednoczęściowy, **GH 2.5 mm**, K 4,5 mm
AW-002-426080	ICX-ACTIVE WHITE implant Ø 4,1 x 8 mm jednoczęściowy, **GH 4,5 mm**, K 4,5 mm
AW-002-426100	ICX-ACTIVE WHITE implant Ø 4,1 x 10 mm jednoczęściowy, **GH 4,5 mm**, K 4,5 mm
AW-002-426125	ICX-ACTIVE WHITE implant Ø 4,1 x 12,5 mm jednoczęściowy, **GH 4,5 mm**, K 4,5 mm
AW-002-426150	ICX-ACTIVE WHITE implant Ø 4,1 x 15 mm jednoczęściowy, **GH 4,5 mm**, K 4,5 mm
C-021-000002	Przenośnik implantu ICX-ACTIVE WHITE

Ø 4,1 mm

Ø 4,1 mm

Wiertła ICX-ACTIVE MASTER

UWAGA! **WAŻNA UWAGA!** UWAGA!

W przypadku wierteł ICX-ACTIVE-MASTER, a także naszych wierteł ICX-PREMIUM, długość wiertła jest o 0,3 mm dłuższa ze względu na końcówkę wiertła - należy upewnić się, że ta dodatkowa długość jest dopuszczalna podczas pracy w obszarze ważnych struktur anatomicznych .

Uwaga:
Paski na wiertle oznaczają twardość kości.

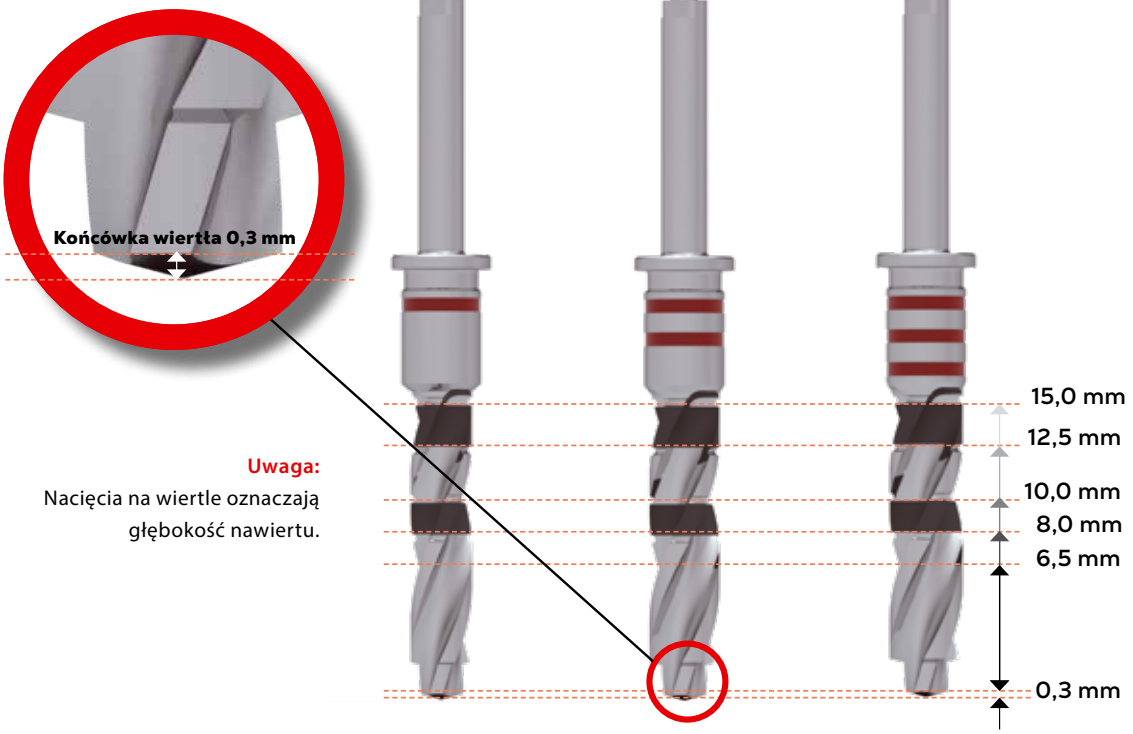

Uwaga:
Nacięcia na wiertle oznaczają głębokość nawiertu.

Wiertło ICX-PREMIUM

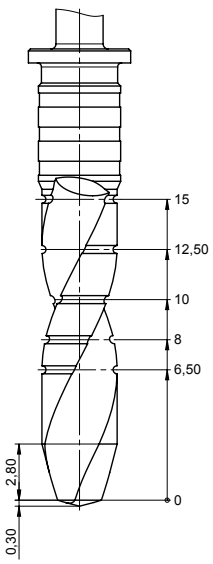

Wiertło ICX-ACTIVE-MASTER

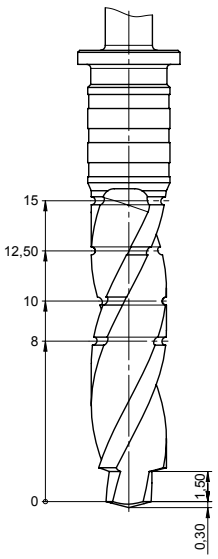

Układ wierteł kasety chirurgicznej

Nr artykułu	Wiertło	Artykuł
ACM-014-003290		Wiertło pilotujące ICX-ACTIVE-MASTER
ACM-014-003375		Wiertło ICX-ACTIVE-MASTER czerwone I Ø 3,75 mm D4
ACM-014-006375		Wiertło ICX-ACTIVE-MASTER czerwone II Ø 3,75 mm D3/D2
ACM-014-007375		Wiertło ICX-ACTIVE-MASTER czerwone III Ø 3,75 mm D1
ACM-014-003410		Wiertło ICX-ACTIVE-MASTER zielone I Ø 4,1 mm D4
ACM-014-006410		Wiertło ICX-ACTIVE-MASTER zielone II Ø 4,1 mm D3/D2
ACM-014-007410		Wiertło ICX-ACTIVE-MASTER zielone III Ø 4,1 mm D1
ACM-014-003480		Wiertło ICX-ACTIVE-MASTER niebieskie I Ø 4,8 mm D4
ACM-014-006480		Wiertło ICX-ACTIVE-MASTER niebieskie II Ø 4,8 mm D3/D2
ACM-014-007480		Wiertło ICX-ACTIVE-MASTER niebieskie III Ø 4,8 mm D1
ACM-014-004375		Gwintownik ICX-ACTIVE-MASTER czerwony Ø 3,75 mm
ACM-014-004410		Gwintownik ICX-ACTIVE-MASTER zielony Ø 4,1 mm
ACM-014-004480		Gwintownik ICX-ACTIVE-MASTER niebieski Ø 4,8 mm
ACM-014-005375		Wiertło ICX-ACTIVE-MASTER kortykalne czerwone Ø 3,75 mm
ACM-014-005410		Wiertło ICX-ACTIVE-MASTER kortykalne zielone Ø 4,1 mm
ACM-014-005480		Wiertło ICX-ACTIVE-MASTER kortykalne niebieskie Ø 4,8 mm

Nr artykułu	Kaseta chirurgiczna ICX-ACTIVE-MASTER
C-018-000112	

zamówienia: +48 32 767 55 66 lub sklep.3z.pl

Śruby zamykające i gojące/tymczasowe

Uwaga: Proszę wkręcać wszystkie śruby zamykające ręcznie. Nie należy przekraczać przy tym momentu obrotowego 5 do 10 Ncm.

Nr artykułu	Artykuł	Materiał	
C-003-000002	Śruba zamykająca ICX jałowa (sterylna) GH 0 mm	Tytan	
C-003-000021	Śruba zamykająca ICX niebieska, Ø 3,1 mm GH 2 mm	Tytan	
C-003-000022	Śruba zamykająca ICX niebieska, Ø 3,75 mm GH 0,5 mm	Tytan	
C-003-000100	Zestaw do techniki ringowej ICX Bone Ring GH 0 mm z dedykowaną śrubą zamykającą i śrubą talerzową *przykręcać kluczem hex 1,2	Tytan	
C-003-000004	Śruba zamykająca dla ICX-mini WYŁĄCZNIE DLA IMPLANTÓW ICX-mini Ø 2,9 mm	Tytan	
C-004-034550	Śruba gojąca 2-częściowa IC-TL, Ø 5 mm, H 5 mm WYŁĄCZNIE DLA IMPLANTÓW ICX-TISSUE LEVEL WKRĘCAĆ Z SIŁĄ max 15 Ncm	PEEK	

Nr artykułu	Artykuł	Wymiary	
C-004-504720	Łącznik tymczasowy ICX gojący, **z hex**, Ø 4,7 mm, PEEK (można sterylizować)	2 mm GH 6 mm K	
C-004-504740	Łącznik tymczasowy ICX gojący, **z hex**, Ø 4,7 mm, PEEK (można sterylizować)	4 mm GH 6 mm K	
C-004-514720	Łącznik tymczasowy ICX gojący, **bez hex**, Ø 4,7 mm, PEEK (można sterylizować)	2 mm GH 6 mm K	
C-004-514740	Łącznik tymczasowy ICX gojący, **bez hex**, Ø 4,7 mm, PEEK (można sterylizować)	4 mm GH 6 mm K	
C-004-524706	Śruba gojąca ICX, do indywidualizacji, z hex, Ø 5 mm, PEEK (można sterylizować)	6,5 mm H	
C-004-524708	Śruba gojąca ICX, do indywidualizacji, z hex, Ø 5 mm, PEEK (można sterylizować)	8,5 mm H	
C-004-524710	Śruba gojąca ICX, do indywidualizacji, z hex, Ø 5 mm, PEEK (można sterylizować)	10,5 mm H	
C-004-526006	Śruba gojąca ICX, do indywidualizacji, z hex, Ø 7 mm, PEEK (można sterylizować)	6,5 mm H	
C-004-526008	Śruba gojąca ICX, do indywidualizacji, z hex, Ø 7 mm, PEEK (można sterylizować)	8,5 mm H	
C-004-526010	Śruba gojąca ICX, do indywidualizacji, z hex, Ø 7 mm, PEEK (można sterylizować)	10,5 mm H	

Zawiera śrubę łączącą C-011-000001-01
Wkręcać ostatecznie z momentem 15 Ncm

zamówienia: +48 32 767 55 66 lub sklep.3z.pl

Śruby gojące standardowe ICX-BONE LEVEL

Nr artykułu	Artykuł	Materiał	
C-004-444720	Śruba gojąca butelkowa Ø 3,9/4,7 mm GH 2 mm H 3,5 mm	Tytan	
C-004-444730	Śruba gojąca butelkowa Ø 3,9/4,7 mm GH 3 mm H 4,5 mm	Tytan	
C-004-444740	Śruba gojąca butelkowa Ø 3,9/4,7 mm GH 4 mm H 5,5 mm	Tytan	
C-004-444750	Śruba gojąca butelkowa Ø 3,9/4,7 mm GH 5 mm H 6,5 mm	Tytan	
C-004-004510	Śruba gojąca Ø 4,7 mm stożkowa GH 1 mm	Tytan	
C-004-004520	Śruba gojąca Ø 4,7 mm stożkowa GH 2 mm	Tytan	
C-004-004530	Śruba gojąca Ø 4,7 mm stożkowa GH 3 mm	Tytan	
C-004-004540	Śruba gojąca Ø 4,7 mm stożkowa GH 4 mm	Tytan	
C-004-004550	Śruba gojąca Ø 4,7 mm stożkowa GH 5 mm	Tytan	
C-004-004560	Śruba gojąca Ø 4,7 mm stożkowa GH 6 mm	Tytan	
C-004-006020	Śruba gojąca Ø 6 mm stożkowa GH 2 mm	Tytan	
C-004-006030	Śruba gojąca Ø 6 mm stożkowa GH 3 mm	Tytan	
C-004-006040	Śruba gojąca Ø 6 mm stożkowa GH 4 mm	Tytan	
C-004-006050	Śruba gojąca Ø 6 mm stożkowa GH 5 mm	Tytan	
C-004-006060	Śruba gojąca Ø 6 mm stożkowa GH 6 mm	Tytan	
C-004-008030	Śruba gojąca Ø 8 mm stożkowa GH 3 mm	Tytan	
C-004-008050	Śruba gojąca Ø 8 mm stożkowa GH 5 mm	Tytan	

Uwaga: GH = Wysokość od brzegu implantu. Kreski na śrubie oznaczają jej wysokość, np. 3 kreski = 3 mm
Wkręcać z siłą 5-10 Ncm. Jeśli śruba zostanie wkręcona z momentem obrotowym przekraczającym 20 Ncm, to istnieje ryzyko, że przy stożku powstaną siły, które uniemożliwią później wykręcenie śruby.

Śruby gojące ICX-TISSUE LEVEL

Wkręcać z siłą 5-10 Ncm

Nr artykułu	Artykuł	Wymiary	Materiał	
C-004-245010	Śruba gojąca ICX-TL	Ø 5 mm 1 mm GH	Tytan	
C-004-245020	Śruba gojąca ICX-TL	Ø 5 mm 2 mm GH	Tytan	
C-004-245030	Śruba gojąca ICX-TL	Ø 5 mm 3 mm GH	Tytan	
C-004-245040	Śruba gojąca ICX-TL	Ø 5 mm 4 mm GH	Tytan	
C-004-245060	Śruba gojąca ICX-TL	Ø 5 mm 6 mm GH	Tytan	

Śruby gojące ICX-TL stożkowe:

- Tworzą rozszerzony profil wyłaniania dla wszystkich kolejnych uzupełnień na łącznikach i bazach adhezyjnych, od GH 0 mm

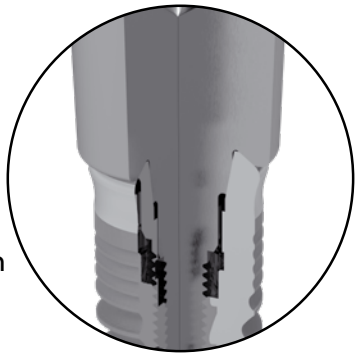

- Chronią platformę implantów podczas procesu gojenia

- Są jednoczęściowe

- Leżą na platformie TL i obejmują okrągły kołnierz implantu 0,25 mm

- Stożek ma 4 stopnie, Ø 5,2 mm

zamówienia: +48 32 767 55 66 lub sklep.3z.pl

Śruby gojące i transfery CERICX

Wkręcać z siłą 5-10 Ncm

Do wytworzenia profilu wyłaniania, który jest odpowiednio zaprojektowany i precyzyjnie dopasowany do łączników hybrydowych CERICX, a także do pobrania następującego po nim wycisku. To sprawia, że jest to kompletny system.

Nr artykułu	Artykuł	Wymiary	Materiał	
C-004-116001	Śruba gojąca do łączników CERICX, złoty kolor. Idealnie pasuje do łącznika prostego 1 mm C-036-A/B/C10501	Ø 6 mm **3 mm GH**	Tytan	
C-004-116002	Śruba gojąca do łączników CERICX, złoty kolor. Idealnie pasuje do łącznika prostego 2 mm C-036-A/B/C10502	Ø 6 mm **4 mm GH**	Tytan	
C-004-116003	Śruba gojąca do łączników CERICX, złoty kolor. Idealnie pasuje do łącznika prostego 3 mm C-036-A/B/C10503	Ø 6 mm **5 mm GH**	Tytan	
C-004-116004	Śruba gojąca do łączników CERICX, złoty kolor. Idealnie pasuje do łącznika prostego 4 mm C-036-A/B/C10504	Ø 6 mm **6 mm GH**	Tytan	
C-005-020005	CERICX transfer wyciskowy do łyżki zamkniętej do łączników hybrydowych	Ø 7 mm 13 mm H	Tytan	
C-005-030011	CERICX transfer wyciskowy do łyżki otwartej do łączników hybrydowych - długi	Ø 5,5 mm 16 mm H	Tytan	
C-005-030012	CERICX transfer wyciskowy do łyżki otwartej do łączników hybrydowych - krótki	Ø 5,5 mm 9 mm H	Tytan	

Łączniki CER-ICX strona 36.

Transfery wyciskowe

Wkręcać z siłą 5-10 Ncm

Nr artykułu		Artykuł	Wymiary	Materiał
C-005-020002		Transfer wyciskowy ICX do łyżki zamkniętej W skład wchodzi: Pozycjoner zamknięty Śruba łącząca Kapturek wyciskowy Wysokość całkowita mierzona od platformy implantu wraz z kapturkiem = 11,5 mm	5 mm H_1 10,5 mm H_2	Tytan
C-005-040002		ICX – kapturek wyciskowy (10 szt. w op.) *nie sterylizować	6,5 mm L	Plastik
C-005-030001		Transfer wyciskowy ICX do łyżki otwartej - krótki W skład wchodzi: Pozycjoner otwarty Śruba łącząca Osłonka	3,3 mm H_1 8 mm H_2	Tytan
C-005-030002		Transfer wyciskowy ICX do łyżki otwartej - długi W skład wchodzi: Pozycjoner otwarty Śruba łącząca Osłonka	5 mm H_1 15,5 mm H_2	Tytan
C-005-020005		CERICX transfer wyciskowy do łyżki zamkniętej do łączników hybrydowych	Ø 7 mm 13 mm H	Tytan
C-005-030011		CERICX transfer wyciskowy do łyżki otwartej do łączników hybrydowych - długi	Ø 5,5 mm 16 mm H	Tytan
C-005-030012		CERICX transfer wyciskowy do łyżki otwartej do łączników hybrydowych - krótki	Ø 5,5 mm 9 mm H	Tytan

zamówienia: +48 32 767 55 66 lub sklep.3z.pl

Analogi implantów

Nr artykułu		Artykuł	Wymiary	Materiał
C-006-010001		Analog implantu ICX **Bone Level (BL)** standardowy	15 mm L	Tytan
C-006-010003		Analog implantu ICX **Bone Level (BL)** CAD/CAM	10 mm L	Tytan
C-006-010008		Analog implantu ICX **Tissue Level (TL)** CAD/CAM	11,7 mm L	Tytan

UWAGA: Podczas pobierania wycisków i odlewania modeli należy zwrócić uwagę na różne platformy implantów **BL** i **TL**. Wybierz odpowiednie analogi laboratoryjne BL i TL (także BL i TL Narrow). Jest to zwłaszcza ważne, przy łącznikach o bardzo niskim profilu wyłaniania (GH 0 mm).

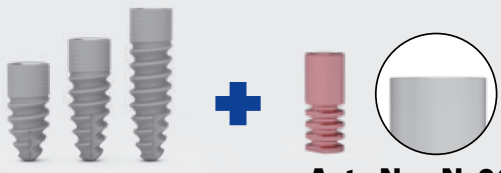

ICX-Ø 3,3 mm BL (Bone Level)
Ø 3,3 mm
Art.-Nr.: N-006-010003

ICX-Ø 3,3 mm TL (Tissue Level)
Ø 3,3 mm
Art.-Nr.: N-006-010008

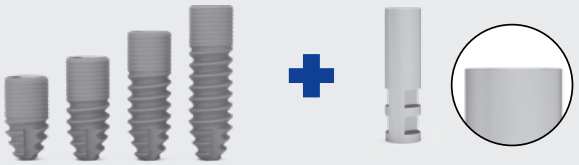

ICX-BL (Bone Level)
Ø 3,75 · Ø 4,1 · Ø 4,8 mm
Art.-Nr.: C-006-010001 / C-006-010003

ICX-TL (Tissue Level)
Ø 3,45 · Ø 3,75 · Ø 4,1 · Ø 4,8 mm
Art.-Nr.: C-006-010008

Łączniki standardowe krótkie

Do prac cementowanych

Nr artykułu		Artykuł	Wymiary	Materiał
C-007-010501	**Ø 5 mm**	Łącznik krótki standardowy **Ø 5 mm**	1 mm GH 4 mm K	Tytan
C-007-010502		Łącznik krótki standardowy **Ø 5 mm**	2 mm GH 4 mm K	Tytan
C-007-010503		Łącznik krótki standardowy **Ø 5 mm**	3 mm GH 4 mm K	Tytan
C-007-010504		Łącznik krótki standardowy **Ø 5 mm**	4 mm GH 4 mm K	Tytan
C-007-010505		Łącznik krótki standardowy **Ø 5 mm**	5 mm GH 4 mm K	Tytan
C-007-010506		Łącznik krótki standardowy **Ø 5 mm**	6 mm GH 4 mm K	Tytan
C-007-016501	**Ø 6,5 mm** 	Łącznik krótki szeroki **Ø 6,5 mm**	1 mm GH 4 mm K	Tytan
C-007-016502		Łącznik krótki szeroki **Ø 6,5 mm**	2 mm GH 4 mm K	Tytan
C-007-016503		Łącznik krótki szeroki **Ø 6,5 mm**	3 mm GH 4 mm K	Tytan

Zawiera śrubę łączącą C-007-000001-01
Wkręcać ostatecznie z momentem 30 Ncm

Dostępna śruba laboratoryjna
C-007-000002

Uwaga:
GH = Profil wyłaniania mierzony od brzegu implantu
K = Wysokość części protetycznej



Łączniki standardowe długie

Do prac cementowanych

Nr artykułu		Artykuł	Wymiary	Materiał
C-007-020501	**Ø 5 mm**	Łącznik długi standardowy **Ø 5 mm**	1 mm GH 7 mm K	Tytan
C-007-020502		Łącznik długi standardowy **Ø 5 mm**	2 mm GH 7 mm K	Tytan
C-007-020503		Łącznik długi standardowy **Ø 5 mm**	3 mm GH 7 mm K	Tytan
C-007-020504		Łącznik długi standardowy **Ø 5 mm**	7 mm GH 7 mm K	Tytan
C-007-020505		Łącznik długi standardowy **Ø 5 mm**	5 mm GH 7 mm K	Tytan
C-007-020506		Łącznik długi standardowy **Ø 5 mm**	6 mm GH 7 mm K	Tytan
C-007-026501	**Ø 6,5 mm**	Łącznik długi szeroki **Ø 6,5 mm**	1 mm GH 7 mm K	Tytan
C-007-026502		Łącznik długi szeroki **Ø 6,5 mm**	2 mm GH 7 mm K	Tytan
C-007-026503		Łącznik długi szeroki **Ø 6,5 mm**	3 mm GH 7 mm K	Tytan

Zawiera śrubę łączącą C-007-000001-01
Wkręcać ostatecznie z momentem 30 Ncm

Dostępna śruba laboratoryjna
C-007-000002

ICX
DAS FAIRE PREMIUM IMPLANTAT-SYSTEM.

Łączniki estetyczne standardowe

UWAGA: Wszystkie kątowe łączniki ICX są łamane na powierzchni płaskiej hexa (antyrotacji).

Nr artykułu		Artykuł	Wymiary	Materiał
C-010-010010	**0°**	Łącznik estetyczny **0° prosty**	**GH 1:** 1,0 mm **GH 2:** 3,0 mm K 7 mm	Tytan
C-010-010030		Łącznik estetyczny **0° prosty**	**GH 1:** 3,0 mm **GH 2:** 5,0 mm K 7 mm	Tytan
C-010-020015	**15°**	Łącznik estetyczny **15°**	**GH 1:** 1,5 mm **GH 2:** 3,5 mm K 7 mm	Tytan
C-010-020025		Łącznik estetyczny **15°**	**GH 1:** 2,5 mm **GH 2:** 4,5 mm K 7 mm	Tytan
C-010-020035		Łącznik estetyczny **15°**	**GH 1:** 3,5 mm **GH 2:** 5,5 mm K 7 mm	Tytan
C-010-020050		Łącznik estetyczny **15°**	**GH 1:** 5,0 mm **GH 2:** 7,0 mm K 7 mm	Tytan
C-010-040015	**25°**	Łącznik estetyczny **25°**	**GH 1:** 1,5 mm **GH 2:** 3,5 mm K 7 mm	Tytan
C-010-040025		Łącznik estetyczny **25°**	**GH 1:** 2,5 mm **GH 2:** 4,5 mm K 7 mm	Tytan
C-010-040035		Łącznik estetyczny **25°**	**GH 1:** 3,5 mm **GH 2:** 5,5 mm K 7 mm	Tytan
C-010-040050		Łącznik estetyczny **25°**	**GH 1:** 5,0 mm **GH 2:** 7,0 mm K 7 mm	Tytan

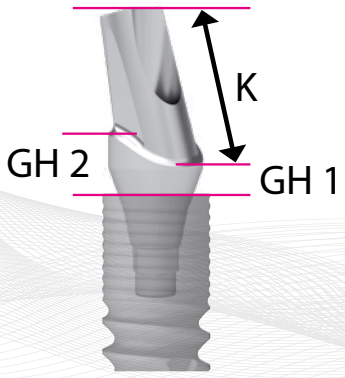

Zawiera śrubę łączącą C-011-000001-01
Wkręcać ostatecznie z momentem 30 Ncm

Dostępna śruba laboratoryjna
C-007-000002

Uwaga:
GH = Profil wyłaniania mierzony od brzegu implantu
K = Wysokość części protetycznej

zamówienia: +48 32 767 55 66 lub sklep.3z.pl

Łączniki estetyczne

Nr artykułu		Artykuł	Wymiary	Materiał
C-010-010005	0° 15° 25° **Tylko dla implantów ICX-Bone Level**	Łącznik estetyczny BL **0° prosty, Ø 4,5 mm**	**GH 1:** 0,5 mm **GH 2:** 1,5 mm K 8 mm	Tytan
C-010-020005		Łącznik estetyczny BL **15°, Ø 4,5 mm**	**GH 1:** 0,5 mm **GH 2:** 1,5 mm K 8 mm	Tytan
C-010-040005		Łącznik estetyczny BL **25°, Ø 4,5 mm**	**GH 1:** 0,5 mm **GH 2:** 1,5 mm K 8 mm	Tytan
C-024-110005	0° 15° 25° **Tylko dla implantów ICX-Tissue Level**	Łącznik estetyczny TL **0° prosty, Ø 4,5 mm**	**GH 1:** 0,3 mm **GH 2:** 1,5 mm K 8 mm	Tytan
C-024-120005		Łącznik estetyczny TL **15°, Ø 4,5 mm**	**GH 1:** 0,3 mm **GH 2:** 1,5 mm K 8 mm	Tytan
C-024-140005		Łącznik estetyczny TL **25°, Ø 4,5 mm**	**GH 1:** 0,3 mm **GH 2:** 1,5 mm K 8 mm	Tytan

 Zawiera śrubę łączącą C-011-000001-01
Wkręcać ostatecznie z momentem 30 Ncm

Dostępna śruba laboratoryjna
C-007-000002

Łączniki standardowe

Nr artykułu		Artykuł	Wymiary	Materiał
C-007-010500	**Tylko dla implantów ICX-Bone Level**	Łącznik zerowy BL, krótki	**0 mm GH** 5 mm K Ø 3,7 mm	Tytan
C-007-020500		Łącznik zerowy BL, średni	**0 mm GH** 7 mm K Ø 3,7 mm	Tytan
C-007-030500		Łącznik zerowy BL, długi	**0 mm GH** 9 mm K Ø 3,7 mm	Tytan
C-024-010501	**Tylko dla implantów ICX-Tissue Level**	Łącznik zerowy TL, krótki	GH 0,25 mm K 5 mm Ø 5 mm	Tytan
C-024-020501		Łącznik zerowy TL, długi	GH 0,25 mm K 7,5 mm Ø 5 mm	Tytan
C-024-120501		Łącznik zerowy TL, bez granicy preparacji	GH 0 mm K 7 mm Ø 4,2 mm	Tytan

 Zawiera śrubę łączącą C-007-000001-01
Wkręcać ostatecznie z momentem 30 Ncm

Dostępna śruba laboratoryjna
C-007-000002

Łączniki jednoczęściowe i uniwersalne

Łączniki lite ICX

Nr artykułu		Artykuł	Wymiary	Materiał
C-021-063200	1)	Łącznik jednoczęściowy krótki **Ø 3,1 mm**	**0 mm GH** 8 mm K	Tytan
C-021-063300		Łącznik jednoczęściowy długi **Ø 3,1 mm**	**0 mm GH** 11 mm K	Tytan
C-021-063401	2)	Łącznik jednoczęściowy **Ø 4,1 mm**	1 mm GH 5,5 mm K	Tytan
C-021-063402		Łącznik jednoczęściowy **Ø 4,1 mm**	2 mm GH 5,5 mm K	Tytan
C-021-063403		Łącznik jednoczęściowy **Ø 4,1 mm**	3 mm GH 5,5 mm K	Tytan
C-021-065001	2)	Łącznik jednoczęściowy **Ø 5 mm**	1 mm GH 5,5 mm K	Tytan
C-021-065002		Łącznik jednoczęściowy **Ø 5 mm**	2 mm GH 5,5 mm K	Tytan
C-021-065003		Łącznik jednoczęściowy **Ø 5 mm**	3 mm GH 5,5 mm K	Tytan
950099		Śrubokręt ICX 1,4 hex **(dla 1)**	24 mm L	Stal nierdzewna
C-021-000002		Nasadkowy klucz ICX do łączników litych **(dla 2)**	25,6 mm L	Stal nierdzewna

Uwaga:
GH = Profil wyłaniania mierzony od brzegu implantu
K = Wysokość części protetycznej
L = Długość całkowita

Uwaga: **Dokręcać z momentem 30 Ncm.** Po wykonaniu wycisku nie należy poluzowywać litego łącznika. Do przygotowania in situ.

Łączniki uniwersalne ICX do indywidualizacji

Nr artykułu		Artykuł	Wymiary	Materiał
C-009-100001		Łącznik uniwersalny krótki Ø 5,2 mm	9,5 mm K	Tytan
C-009-100002		Łącznik uniwersalny długi Ø 5,2 mm	14,5 mm K	Tytan
C-009-020001		Łącznik teleskopowy Meso Ø 7 mm	9 mm K	Tytan

Zawiera śrubę łączącą C-011-000001-01
Wkręcać ostatecznie z momentem 30 Ncm

Dostępna śruba laboratoryjna
C-007-000002

Ze względu na grubsze ścianki mogą być do pewnego stopnia indywidualnie szlifowane przez technika jako teleskopy główne.

zamówienia: +48 32 767 55 66 lub sklep.3z.pl

System belkowy ICX

Nr artykułu		Artykuł	Wymiary	Materiał
C-011-030001		Łącznik plastikowy ulega wypaleniu **z hex**	9 mm L 6,3 mm K Ø 4,5 mm	Tworzywo sztuczne do wypalania
C-011-030002		Łącznik plastikowy ulega wypaleniu **bez hex**	9 mm L 6,3 mm K Ø 4,5 mm	Tworzywo sztuczne do wypalania
C-011-020002		Łącznik krótki **bez hex**	9 mm L 6,3 mm K Ø 4,5 mm	Tytan
C-011-020003		Łącznik długi **bez hex**	13,5 mm L 6,3 mm K Ø 4,5 mm	Tytan

Łączniki do wypalania i nadlewania

Nr artykułu		Artykuł	Wymiary	Materiał
C-008-010001		Łącznik ze złota Ø 5 mm **z hex**	1 mm GH	Złoto/ Stop-HSL Ceramicor
C-008-010002		Łącznik ze złota Ø 5 mm **bez hex**	1 mm GH	Złoto/ Stop-HSL Ceramicor
C-008-020001		Łącznik chromokobaltowy z tuleją POM 9 mm **(może być napalany metalem nieszlachetnym)** **z hex**	Ø 4,40 mm 0,75 mm GH 5 mm K	CoCr Biodur CCM/BC (należy zwrócić uwagę na wartości WRC podczas napalania na ceramice)
C-008-030001		Łącznik plastikowy Ø 5 mm **z hex** **spalany bezresztkowo**	1 mm GH 7 mm K	Tworzywo sztuczne do wypalania
C-008-030002		Łącznik plastikowy Ø 5 mm **bez hex** **spalany bezresztkowo**	1 mm GH 7 mm K	Tworzywo sztuczne do wypalania

Zawiera śrubę łączącą C-011-000001-01
Wkręcać ostatecznie z momentem 30 Ncm

Dostępna śruba laboratoryjna
C-007-000002

Uwaga:
GH = Profil wyłaniania mierzony od brzegu implantu
K = Wysokość części protetycznej od załamania
L = Wysokość części protetycznej od brzegu implantu



Struktury CoCr wykonane są ze stopu kobaltowo-chromowego zgodnie z ISO 5832-12. CTE: 14,1 x 10-6 (20-500 ° C). Wypalana plastikowa tuleja wykonana jest z polioksymetylenu (POM).

Łączniki do prac cementowanych ICX-CEREC®

ICX-Cerec® Bazy WYŁĄCZNIE dla systemu Sirona®

Nr artykułu		Artykuł	Wymiary	Materiał
C-029-000050		Baza TiBase ICX-Cerec L-Block do prac cementowanych, z hex w zestawie z czapeczką do skanowania	1 mm GH 4,65 mm K Ø 4,5 mm	Tytan
C-030-000052		Łącznik do skanowania ICX-Cerec **Scanpost** L z hex w zestawie z czapeczką do skanowania	2,5 mm GH 4,65 mm K Ø 4,5 mm	Tytan
C-029-000051		Baza TiBase ICX-Cerec L-Block do prac cementowanych, z hex w zestawie z czapeczką do skanowania	2,5 mm GH 4,5 mm K Ø 4,5 mm	Tytan
C-030-000053		Łącznik do skanowania ICX-Cerec **Scanpost** L z hex w zestawie z czapeczką do skanowania	4 mm GH 4,65 mm K Ø 4,5 mm	Tytan
6431329		Czapeczka do skanowania szara (Omnicam)	–	PEEK

Zawiera śrubę łączącą C-011-000001-01
Wkręcać ostatecznie z momentem 30 Ncm

Dostępna śruba laboratoryjna
C-007-000002

Uwaga:
GH = Profil wyłaniania mierzony od brzegu implantu
K = Wysokość części protetycznej

Uwaga: Generalnie zawsze zaleca się skanowanie za pomocą odpowiedniego scanposta! Podczas skanowania z bazy danych wybierz kartotekę **NB A 4,5** . W przypadku skanowania niższego TiBase należy użyć tej samej wysokości TiBase przy cementowaniu odbudowy. W przypadku skanowania wyższego lub niższego Scanposta należy użyć odpowiednio wyższego lub niższego TiBase podczas cementowania odbudowy.

zamówienia: +48 32 767 55 66 lub sklep.3z.pl

Bazy tytanowe do cementowania

Nr artykułu		Artykuł	Wymiary	Materiał
C-029-000004		Łącznik do cementowania Ø 4,4 mm z hex **Wyłącznie dla implantów ICX-BL !**	**0 mm GH** 4 mm K	Tytan
C-029-000005		Łącznik do cementowania Ø 4,4 mm z hex **Wyłącznie dla implantów ICX-TL !**	**0 mm GH** 4 mm K	Tytan
C-029-000002		Łącznik do cementowania Ø 4,4 mm z hex	0,5 mm GH 4 mm K	Tytan
C-029-000008		Łącznik do cementowania Ø 4,4 mm z hex	1,5 mm GH 4 mm K	Tytan
C-029-000007		Łącznik do cementowania Ø 4,4 mm z hex	2,5 mm GH 4 mm K	Tytan
C-029-000021		Łącznik do cementowania do systemu ZirkonZahn Ø 5,1 mm z hex	1 mm GH 4 mm K	Tytan
C-029-001001		Baza do cementowania pod belki i mosty **Ø 3,8 mm** **bez hex**	0,5 mm GH 3,8 mm K	Tytan
C-030-000001		Łącznik ICX do skanowania na modelu Scanbody CAD/CAM 1 generacji	L 12 mm	PEEK
C-030-000004		Łącznik ICX do skanowania wewnątrzustnego oraz na modelu do premili i bazy Medentika® (zamiennik CX 1400)		PEEK
C-030-000003		Łącznik ICX do skanowania wewnątrzustnego oraz na modelu Scanbody CAD/CAM 2 generacji	L 12 mm	PEEK

Zawiera śrubę łączącą C-011-000001-01
Wkręcać ostatecznie z momentem 30 Ncm

Dostępna śruba laboratoryjna
C-007-000002

Uwaga:
GH = Profil wyłaniania mierzony od brzegu implantu
K = Wysokość części protetycznej

Elementy ICX-CAD/CAM do frezarek

PREMILLE dostępne dla następujących systemów:

ICX-System®
(MED-)

Medentika®
(MDK-)

Amann Girrbach®
(AGH-)

Nasza seria łączników premill jest stale poszerzana o kolejne systemy.
Dowiedz się więcej w naszym sklepie internetowym ICX!

Premille

Nr Artykułu		Artykuł	Wymiary	Materiał
D5-023-010004 D5-023-011004		Premill **ICX-NARROW** z hex **Tylko do implantów ICX-NARROW Ø 3,30 mm** **Premium / Active Master BL**	11,5 mm Ø 16 mm Ø	Tytan
D5-023-010001 D5-023-011001 D5-023-111001		Premill ICX Premum / Active Master, z hex Pasuje do TL oraz BL	11,5 mm Ø 16 mm Ø 16 mm Ø	Tytan Tytan CoCr
D5-023-010002 D5-023-011002		Premill zerowy **ICX-TL** z hex, **0 mm GH** **Tylko do implantów ICX-TISSUE LEVEL** **Ø 3,45 mm, Ø 3,75 mm, Ø 4,1 mm, Ø 4,8 mm**	11,5 mm Ø 16 mm Ø	Tytan
D5-023-010003 D5-023-011003		Premill zerowy **ICX-BL** z hex, **0 mm GH** **Tylko do implantów ICX-BONE LEVEL** **Ø 3,75 mm, Ø 4,1 mm, Ø 4,8 mm**	11,5 mm Ø 16 mm Ø	Tytan
D5-023-040001		Premill ICX Premum / Active Master (BL) Amann Girrbach, **z hex**	11,8 mm Ø	Tytan
D5-023-030001 D5-023-031001 D5-023-131001		Premill ICX Premum / Active Master (BL) Medentika, **z hex**	11,5 mm Ø 16 mm Ø 16 mm Ø	Tytan Tytan CoCr
D5-023-020001 D5-023-021001		Premill ICX Premum / Active Master (BL) Arum, **z hex**	10 mm Ø 14 mm Ø	Tytan Tytan

Połączenia łączników i mocowania zaciskowe specyficzne dla maszyny dostarczane dla odpowiednich systemów innych firm mogą być używane z biblioteką dostarczoną przez odpowiedniego producenta. Odpowiednia biblioteka CAD jest dostępna dla następujących systemów: -3Shape -Exocad i jest dostępna online pod adresem
https://medentis.com/icx-service/download-cad-data/
Uchwyt medentis (ICX) jest zintegrowany z następującym oprogramowaniem CAM: VHF Deutschland®, V5 (Imes Icore) ®, Hyper Dent®, Dental Works®.
Złącze (uchwyt) łącznika MED- jest odpowiednie dla systemu trzymającego medentis i Sirona-Cerec®.

Przykładowa ramka pasująca do frezarki MB Maschinen Cobra Mill 5A1, 5M może jednorazowo trzymać cztery premille ICX z uchwytem MED-

Potrzebujesz innej ramki ? zapytaj nas lub dostawcę swojej frezarki.

System kulowy ICX-t-bona

ICX Ø3,45/3,75/4,1/4,8 mm

Nr artykułu		Artykuł	Wymiary	Materiał
C-022-060001		ICX-t-bona łącznik kulowy, 1 mm	1 mm GH	Tytan
C-022-060002		ICX-t-bona łącznik kulowy, 2 mm	2 mm GH	Tytan
C-022-060003		ICX-t-bona łącznik kulowy, 3 mm	3 mm GH	Tytan
C-022-060004		ICX-t-bona łącznik kulowy, 4 mm	4 mm GH	Tytan
C-015-100007		Klucz ICX-t-bona do montażu łączników kulowych	19 mm L	Stal nierdzewna

Uwaga: Ø kulki 2,25 mm, Ø całkowita łącznika 3,8 mm. Wkręcać ostatecznie z siłą 30 Ncm.

ICX-Bonespreader-Box Zestaw do rozszczepiania wyrostka

Nr artykułu		Artykuł	Materiał
C-032-100001		ICX-Bonespreader-Box Pudełko z wyposażeniem jak poniżej	Tworzywo
C-014-600001		ICX-BoneSpreader Nr. 1	Tytan
C-014-600002		ICX-BoneSpreader Nr. 2	Tytan
C-014-600003		ICX-BoneSpreader Nr. 3	Tytan
C-014-600004		ICX-BoneSpreader Nr. 4	Tytan
960001		Klucz dynamometryczny (raczeta)	Stal
960007		Adapter uniwersalny (ręczny)	Stal
C-021-000002		Nasadkowy klucz ICX czworokątny m.in. do montażu łączników litych, OCC, przenośnik implantów ICX-WHITE	Stal
C-032-000007		Klucz redukcyjny do wiertła Ø 2,0 mm	Stal
C-032-020110		Wiertło uniwersalne pilotujące Ø 2,0 mm / 10 mm	Stal

Zestawem można pracować przez szablon lub bezpośrednio z ręki. Piła do nacięć wzdłużnych i pionowych dostępna do dokupienia osobno.

zamówienia: +48 32 767 55 66 lub sklep.3z.pl

T-ecco

Nr artykułu		Artykuł	Materiał
T-13825		T-Ecco matryca kompletna (włącznie ze złotą matrycą wewnętrzną, z czerwonym pierścieniem z tworzywa sztucznego)	Tytan AuPtAgCu
T-13836		T-Ecco matryca zewnętrzna bez wewnętrznej złotej wkładki retencyjnej	Tytan
EK-833100		T-Ecco Analog kulowy	Mosiądz
T-13833		T-Ecco złota wkładka retencyjna do aktywacji	AuPtAgCu
T-13845		T-Ecco mocna wkładka retencyjna, liliowa	Tytan
T-13846		T-Ecco słaba wkładka retencyjna, złota	Tytan
T-10571	Aktywacja Deaktywacja	Aktywator/deaktywator T-Ecco	Stal Nierdzewna
960002		Klucz sześciokątny 0,9 mm, na kątnicę, 20 mm L do matryc wewnętrznych T-ecco i śrub zamykających ICX-mini	Stal Nierdzewna
C-015-100029		Klucz sześciokątny 0,9 mm, ręczny, 35 mm L do matryc wewnętrznych T-ecco i śrub zamykających ICX-mini	Stal Nierdzewna

Dalbo®-PLUS

Nr artykułu		Artykuł	Materiał
DP-055890		Matryca Dalbo PLUS kompletny element żeński TE (z analogiem)	Tytan+Elitor
DP-055643		Dalbo PLUS wkładka retencyjna (bez nacięć) dla kulek o średnicy Ø 2,23-2,26 mm	Elitor
DP-050068		Dalbo PLUS Tuning-Soft - wkładka retencyjna (1 nacięcie) dla kulek o średnicy Ø 2,2-2,23 mm	Elitor
DP-055687		Dalbo PLUS Tuning - wkładka retencyjna (2 nacięcia) dla kulek o średnicy Ø 2,17-2,2 mm	Elitor
DP-072609		Aktywator Dalbo PLUS	Stal Nierdzewna

Uwaga: Zakres retencji wynosi od 200 do ponad 1200 gram. Rozbieżność łączników od osi implantów może wynosić maksymalnie 20° na łącznik. Podstawowa retencja jest w pozycji zero, każde 1/4 obrotu zwiększa retencję o ok 200 g aż do maksymalnej retencji po ok półtora obrotu. Wkładka retencyjna może zostać wymieniona bez konieczności wymiany całego gniazda.

ICX–Maximus kompatybilny z systemem LOCATOR™

Nadbudowa ICX-Maximus jest opatentowaną przez medentis medical alternatywą dla nadbudów LOCATOR™.

Łączniki dla implantów Ø 3,45/3,75/4,1/4,8 mm

Nr artykułu		Artykuł	Wymiary	Materiał
C-031-020001		Patryca jednoczęściowa ICX-Maximus	1 mm GH	Tytan
C-031-020002		Patryca jednoczęściowa ICX-Maximus	2 mm GH	Tytan
C-031-020003		Patryca jednoczęściowa ICX-Maximus	3 mm GH	Tytan
C-031-020004		Patryca jednoczęściowa ICX-Maximus	4 mm GH	Tytan
C-015-100018		Śrubokręt trójkątny do lokatora krótki	25 mm L	Stal
C-015-100031		Śrubokręt trójkątny do lokatora długi	30 mm L	Stal
C-031-010005		Patryca dwuczęściowa ICX-Maximus *dostępne także pozostałe wysokości (1-4 mm) Zawiera śrubę łączącą C-031-000001 Wkręcać kluczem hex 1,4	5 mm GH	Tytan

Uwaga: Istnieje dodatkowa odległość 0,5 mm na łączniku między poziomem implantu a dolnym poziomem, na którym mierzy się wysokość dziąsła. Wkręcać ostatecznie z momentem 30 Ncm



Wymiary T-bona vs Maximus

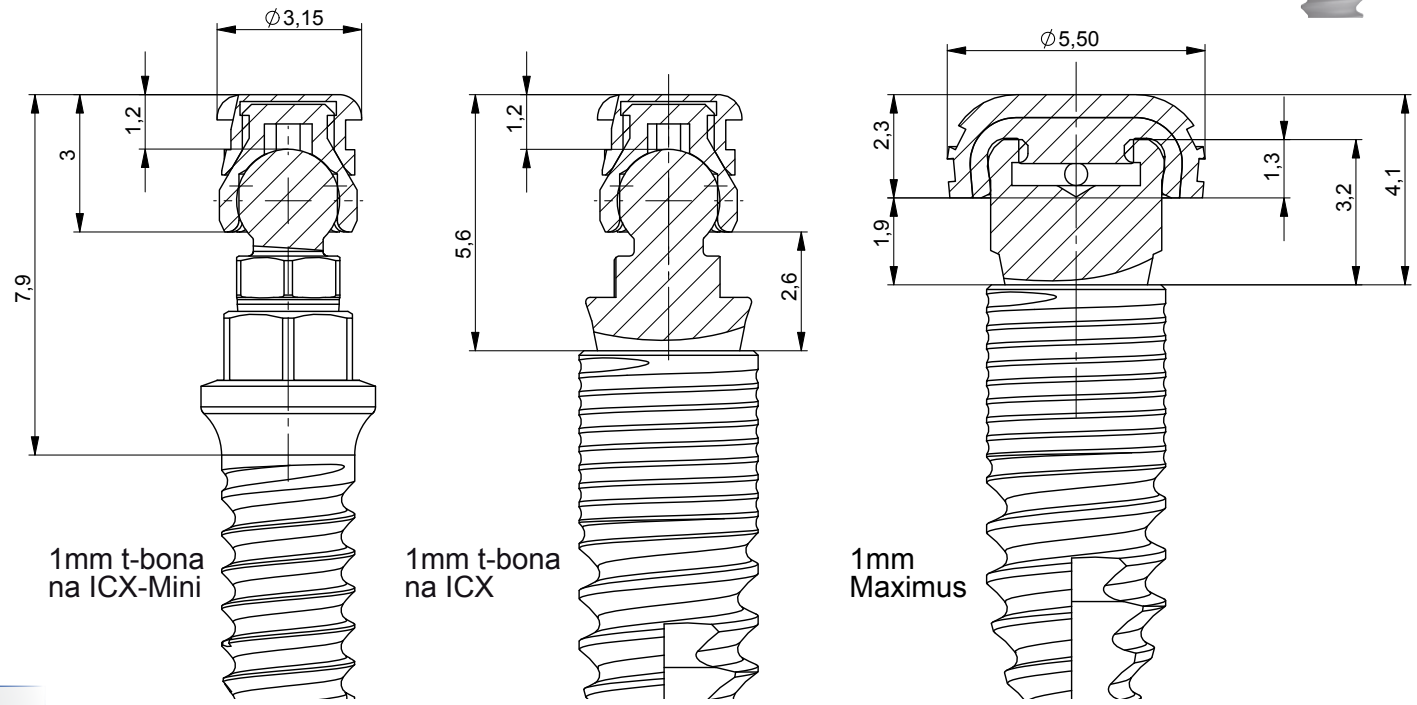

zamówienia: +48 32 767 55 66 lub sklep.3z.pl

Elementy protetyczne i narzędzia

Nr artykułu		Artykuł	Materiał
C-031-853500		Locator™- wkł. retencyjna czarna (op. 4 szt.) techniczna	Tworzywo
C-031-852900		Locator™- wkł. retencyjna niebieska (op. 4 szt.) retencja ok. 680 g, maks. odchył od osi implantu ± 10°	Tworzywo
C-031-854800		Locator™- wkł. retencyjna czerwona (op. 4 szt.) retencja ok. 680 g, maks. odchył od osi implantu ± 20°	Tworzywo
C-031-852700		Locator™- wkł. retencyjna różowa (op. 4 szt.) retencja ok. 1360 g, maks. odchył od osi implantu ± 10°	Tworzywo
C-031-854700		Locator™- wkł. retencyjna zielona (op. 4 szt.) retencja ok. 1360 g, maks. odchył od osi implantu ± 20°	Tworzywo
C-031-852400		Locator™- wkł. retencyjna przeźr. (op. 4 szt.) retencja ok. 2266 g, maks. odchył od osi implantu ± 10°	Tworzywo
C-031-851910		Matryca kompletna Locator™ (obudowa + podkładka dystansująca + wkładki: czarna, niebieska, czerwona, różowa, przeźroczysta)	Tytan Tworzywo
C-031-852300		Podkładka dystansująca (op. 2 szt.)	Tworzywo
C-015-100032		Core Tool - Narzędzie wielofunkcyjne	Stal
C-031-850501		Transfer wyciskowy z poziomu łącznika Maximus (op. 4 szt.)	Tytan
C-031-853000		Locator™- analog modelu Ø 4 mm (op. 4 szt.)	Tytan
CM-031-03482		Zestaw podstawowy CM LOC® (op. 2 szt.) składający się z: 2 x obudowa CM LOC® do wkładek Pekkton® 2 x wkładka retencyjna CM LOC® ~400g 2 x wkładka retencyjna CM LOC® ~1200g 2 x wkładka retencyjna CM LOC® ~1800g 2 x wkładka retencyjna CM LOC® ~2400g 2 x wkładka techniczna CM LOC® 2 x podkładka dystansująca CM LOC®	Tytan Tworzywo
07000205		Narzędzie wielofunkcyjne CM LOC® Multi-Tool (niezbędne)	

Protetyka przykręcana - łączniki pośrednie

4-ON-ICX 6-ON-ICX

Koncepcja protetyczna przywrócenia uzębienia bezzębnym pacjentom. Implanty mogą być ustawione pod kątem 17° lub 35° a kąt jest kompensowany przez łączniki ICX-multi, które są łącznikami pośrednimi - na nich przykręca się pracę ostateczną.

Nr artykułu		Artykuł	Wymiary	Materiał
C-020-751705		Łącznik **17°** ICX-multi, 0,5 mm **z hex**	0,5/1,9 mm GH 2,2 mm K	Tytan
C-020-751715		Łącznik **17°** ICX-multi, 1,5 mm **z hex**	1,5/2,9 mm GH 2,2 mm K	Tytan
C-020-751725		Łącznik **17°** ICX-multi, 2,5 mm **z hex**	2,5/3,9 mm GH 2,2 mm K	Tytan
C-020-751735		Łącznik **17°** ICX-multi, 3,5 mm **z hex**	3,5/4,9 mm GH 2,2 mm K	Tytan
C-020-753505		Łącznik **35°** ICX-multi, 0,5 mm **z hex**	0,5/3,25 mm GH 2,2 mm K	Tytan
C-020-753515		Łącznik **35°** ICX-multi, 1,5 mm **z hex**	1,5/4,25 mm GH 2,2 mm K	Tytan
C-020-753525		Łącznik **35°** ICX-multi, 2,5 mm **z hex**	2,5/5,25 mm GH 2,2 mm K	Tytan
C-020-753535		Łącznik **35°** ICX-multi, 3,5 mm **z hex**	3,5/6,25 mm GH 2,2 mm K	Tytan
C-020-851705		Łącznik **17°** ICX-multi, 0,5 mm **bez hex**	0,5/1,9 mm GH 2,2 mm K	Tytan
C-020-851715		Łącznik **17°** ICX-multi, 1,5 mm **bez hex**	1,5/2,9 mm GH 2,2 mm K	Tytan
C-020-851735		Łącznik **17°** ICX-multi, 3,5 mm **bez hex**	3,5/4,9 mm GH 2,2 mm K	Tytan
C-020-853505		Łącznik **35°** ICX-multi, 0,5 mm **bez hex**	0,5/3,25 mm GH 2,2 mm K	Tytan
C-020-853515		Łącznik **35°** ICX-multi, 1,5 mm **bez hex**	1,5/4,25 mm GH 2,2 mm K	Tytan
C-020-853535		Łącznik **35°** ICX-multi, 3,5 mm **bez hex**	3,5/6,25 mm GH 2,2 mm K	Tytan
C-020-750010		Łącznik prosty ICX-multi, 1 mm bez hex	1 mm GH 2,2 mm K	Tytan
C-020-750020		Łącznik prosty ICX-multi, 2 mm bez hex	2 mm GH 2,2 mm K	Tytan
C-020-750030		Łącznik prosty ICX-multi, 3 mm bez hex	3 mm GH 2,2 mm K	Tytan
C-020-750040		Łącznik prosty ICX-multi, 4 mm bez hex	4 mm GH 2,2 mm K	Tytan
C-020-750050		Łącznik prosty ICX-multi, 5 mm bez hex	5 mm GH 2,2 mm K	Tytan
C-020-750000		Łącznik prosty ICX-multi 0 mm bez hex **TYLKO DLA IMPLANTÓW BONE LEVEL !**	0 mm GH 2,2 mm K Ø 4,8 mm	Tytan
C-020-750001		Łącznik prosty ICX-multi 0 mm bez hex **TYLKO DLA IMPLANTÓW TISSUE LEVEL !**	0 mm GH 2,2 mm K Ø 4,8 mm	Tytan



Zawiera śrubę łączącą C-020-000010-01
Wkręcać ostatecznie z momentem 30 Ncm

zamówienia: +48 32 767 55 66 lub sklep.3z.pl

Protetyka przykręcana - akcesoria i łączniki protetyczne

Wymagana minimalna wysokość nadbudowy 5,5 mm. ICX-multi nie nadaje się na pojedyncze korony.

Nr artykułu		Artykuł	Wymiary	Materiał
C-003-000005		ICX-multi kapturek ochronny	Ø 4,8 mm 4,6 mm L	Tytan
C-005-070001		ICX-multi transfer wyciskowy zamknięty	11 mm L	Tytan
C-005-070020		ICX-multi transfer wyciskowy otwarty długi	16,7 mm L	Tytan
C-005-070002		ICX-multi transfer wyciskowy otwarty krótki	13 mm L	Tytan
C-006-010007		ICX-multi analog krótki CAD/CAM	11 mm L 2,2 mm K	Tytan
C-020-951120		ICX-multi łącznik protetyczny może być skrócony do 4,1 mm	Ø 4,8 mm 12 mm L	Tytan
C-020-952120		ICX-multi łącznik protetyczny może być skrócony do 4,1 mm	Ø 4,8 mm 12 mm L	Tworzywo do wypalania
C-020-953120		ICX-multi uzupełnienie tymczasowe / rejestracja zwarcia, może być skrócony do 4,1 mm (*15 Ncm)	Ø 4,8 mm 12 mm L	Peek
C-020-955120		ICX-multi łącznik do konstrukcji spawanych za pomocą tytanowego drutu 1 gen.	Ø 4,8 mm 12 mm L	Tytan
C-020-955121		ICX-multi łącznik do konstrukcji spawanych za pomocą tytanowego drutu 2 gen.	Ø 5,1 mm 10,5 mm L	Tytan
C-020-956120		ICX-multi łącznik protetyczny zawiera patyczek zabezp. kanał śruby	Ø 4,8 mm 7 mm L	CoCr Biodur CCM/BC
C-029-002010		ICX-multi podstawa do cementowania	Ø 4,8 mm 5,5 mm L 1,5 mm GH	Tytan
C-029-002011		ICX-multi podstawa do cementowania	Ø 5,4 mm 5,5 mm L 0 mm GH	Tytan
C-030-000010		ICX-multi podstawa do skanowania	12,5 mm L 4,5 mm B 6,5 mm T	Peek
C-031-100001		ICX-Maximus (lokator) do ICX-multi 3 mm GH nie licząc wysokości GH multiunitu	Ø 4,8 mm 4,4 mm L	Tytan
C-015-100030		Klucz sześciokątny lity ręczny 1,2 mm Hex do śrub i łączników kątowych ICX-multi oraz ICX-Narrow	24 mm L	Stal nierdzewna
C-020-000001		Klucz nasadkowy 3,2 mm do łączników prostych ICX-multi		Stal nierdzewna
C-020-000120		Multi kołek mocujący do wykonywania wycisków podścielających (10 szt. w op.)		Tworzywo

Zawiera śrubę łączącą C-020-000011-01
Wkręcać ostatecznie z momentem 27 Ncm

Łączniki hybrydowe

0° ORAZ 15° STOPNI - ZE ZOPTYMALIZOWANĄ GRANICĄ PREPARACJI DLA SYSTEMÓW SKANOWANIA WEWNĄTRZUSTNEGO I CEREC® W 3 KOLORACH I 5 WYSOKOŚCIACH DZIĄSŁA:

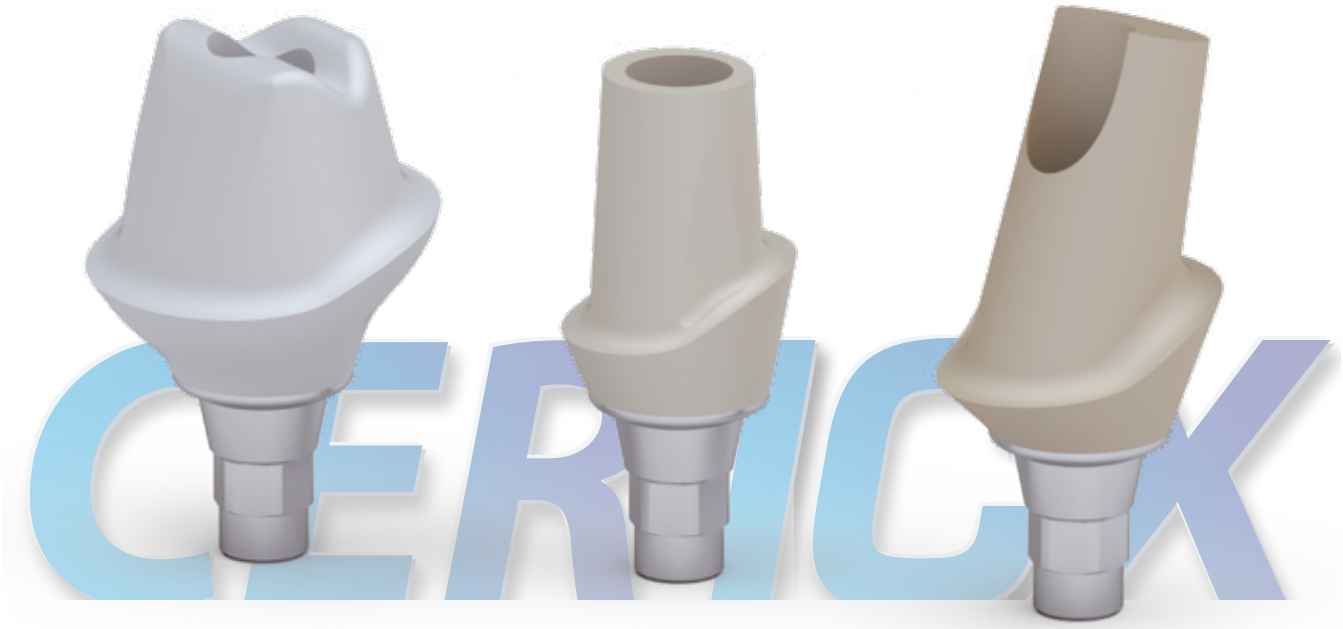

A „jasny“
Kolor zębów ok A1/A2/B1

B „standard“
Kolor zębów ok A3,B2

C „ciemny“
Kolor zębów ok A3,5/B3

KORZYŚCI DLA CIEBIE I TWOICH PACJENTÓW

• Brak konieczności pobierania wycisków • Obniżone koszty laboratoryjne
• Redukcja kosztów analogu i modelu • Redukcja błędów związanych z transferami
• Mniej sesji oraz nowi pacjenci pozyskani dzięki „metodzie bezwyciskowej“

B Kolor zębów „standard“ dla zębów trzonowych

porównywalny: ok. A3/B2

Nr artykułu		Artykuł	Wymiary	Materiał
C-034-B 00525		CERICX Łącznik trzonowy 2,5 mm Profil wyłaniania typowy dla zęba trzonowego	Szerokość Ø 9,6 mm Głębokość Ø 8,1 mm 3,2/5.2 mm GH 6,8 mm K	Cyrkon/Tytan Kolor: B
C-034-B 00535		CERICX Łącznik trzonowy 3,5 mm Profil wyłaniania typowy dla zęba trzonowego	Szerokość Ø 9,6 mm Głębokość Ø 8,1 mm 4,2/6.2 mm GH 6,8 mm K	Cyrkon/Tytan Kolor: B

Nr artykułu	Kolor	Artykuł	Wymiary	Materiał/Kolor
C-036-A10501 C-036-B10501 C-036-C10501		CERICX Łącznik prosty 1 mm	Szerokość Ø 5,5 mm Głębokość Ø 5,8 mm 1,2/3,1 mm GH 6,5 mm K	Cyrkon/Tytan Kolor: A/B/C
C-036-A10502 C-036-B10502 C-036-C10502		CERICX-Łącznik prosty 2 mm	Szerokość Ø 5,5 mm Głębokość Ø 5,8 mm 2,2/4,1 mm GH 6,5 mm K	Cyrkon/Tytan Kolor: A/B/C
C-036-A10503 C-036-B10503 C-036-C10503		CERICX-Łącznik prosty 3 mm	Szerokość Ø 5,5 mm Głębokość Ø 5,8 mm 3,2/5,1 mm GH 6,5 mm K	Cyrkon/Tytan Kolor: A/B/C
C-036-A10504 C-036-B10504 C-036-C10504		CERICX-Łącznik prosty 4 mm	Szerokość Ø 5,5 mm Głębokość Ø 5,8 mm 4,2/6,1 mm GH 6,5 mm K	Cyrkon/Tytan Kolor: A/B/C
C-036-A10505 C-036-B10505 C-036-C10505	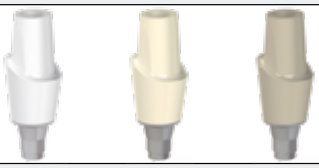	CERICX-Łącznik prosty 5 mm	Szerokość Ø 5,5 mm Głębokość Ø 5,8 mm 5,2/7,1 mm GH 6,5 mm K	Cyrkon/Tytan Kolor: A/B/C
C-036-A20005 C-036-B20005 C-036-C20005		CERICX-15° Łącznik kątowy 0,5 mm	Szerokość Ø 5,5 mm Głębokość Ø 7,2 mm 1,2/3,2 mm GH 7 mm K	Cyrkon/Tytan Kolor: A/B/C
C-036-A20015 C-036-B20015 C-036-C20015		CERICX-15° Łącznik kątowy 1,5 mm	Szerokość Ø 5,5 mm Głębokość Ø 7,2 mm 2,2/4,2 mm GH 7 mm K	Cyrkon/Tytan Kolor: A/B/C
C-036-A20025 C-036-B20025 C-036-C20025		CERICX-15° Łącznik kątowy 2,5 mm	Szerokość Ø 5,5 mm Głębokość Ø 7,2 mm 3,2/5,2 mm GH 7 mm K	Cyrkon/Tytan Kolor: A/B/C
C-036-A20035 C-036-B20035 C-036-C20035		CERICX-15° Łącznik kątowy 3,5 mm	Szerokość Ø 5,5 mm Głębokość Ø 7,2 mm 4,2/6,2 mm GH 7 mm K	Cyrkon/Tytan Kolor: A/B/C
C-036-A20045 C-036-B20045 C-036-C20045		CERICX-15° Łącznik kątowy 4,5 mm	Szerokość Ø 5,5 mm Głębokość Ø 7,2 mm 5,2/7,2 mm GH 7 mm K	Cyrkon/Tytan Kolor: A/B/C







Zawiera śrubę łączącą C-011-000001-01
Wkręcać ostatecznie z momentem 30 Ncm

Dostępna śruba laboratoryjna
C-007-000002

Przenośniki implantów

Przy 35 Ncm pierwotnej stabilizacji można obciążyć implant natychmiastowo.

Nr artykułu		Artykuł	Materiał
C-015-100001		Maszynowy przenośnik implantów ICX krótki (na kątnicę) do implantów ICX Ø 3,45/3,75/4,1/4,8 mm	Stal nierdzewna
C-015-100002		Maszynowy przenośnik implantów ICX krótki (na kątnicę) do implantów ICX Ø 3,45/3,75/4,1/4,8 mm	Stal nierdzewna
C-015-100004		Maszynowy przenośnik implantów ICX krótki (na kątnicę) do implantów ICX Ø 3,45/3,75/4,1/4,8 mm	Stal nierdzewna
C-015-100006		Maszynowy przenośnik implantów ICX (na kątnicę) do implantu ICX Ø 2,9 mm	Stal nierdzewna
C-015-100035		Ręczny przenośnik implantów ICX Ø 3,45/3,75/4,1/4,8 mm Innowacyjny system blokujący - mikrokulka	Stal nierdzewna
C-015-100040		Maszynowy przenośnik implantów ICX średni (na kątnicę) do implantów ICX Ø 3,45/3,75/4,1/4,8 mm Innowacyjny system blokujący - mikrokulka	Stal nierdzewna
C-021-000002		Ręczny przenośnik implantów cyrkonowych ICX-WHITE- oraz łączników jednoczęściowych (C-021-)	Stal nierdzewna
C-015-100000		Ręczny przenośnik implantów ICX przykręcany **Tylko do implantów Bone Level**	Stal nierdzewna
C-015-110000		Maszynowy przenośnik implantów ICX przykręcany **Tylko do implantów Bone Level**	Stal nierdzewna

Sposób wyjmowania implantu z fiolki i montażu śruby zamykającej/gojącej:

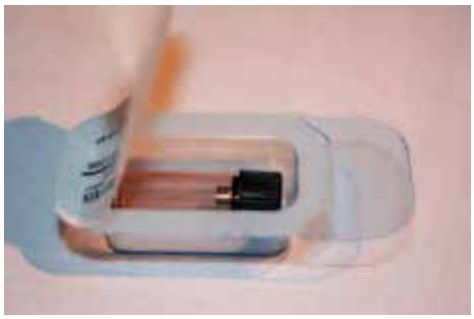

zamówienia: +48 32 767 55 66 lub sklep.3z.pl

Klucze

Nr artykułu		Artykuł	Materiał
950099		Klucz sześciokątny 1,4 mm średni 24 mm standardowy do śrub oraz łączników	Stal nierdzewna
950098		Klucz sześciokątny 1,4 mm długi 28 mm standardowy do śrub oraz łączników	Stal nierdzewna
950097		Klucz sześciokątny 1,4 mm super długi 45 mm standardowy do śrub oraz łączników	Stal nierdzewna
960002		Klucz sześciokątny 0,9 mm na kątnicę do matryc wewnętrznych T-ecco i śrub zamykających ICX-mini	Stal nierdzewna
C-015-100029		Klucz sześciokątny 0,9 mm ręczny 35 mm do matryc wewnętrznych T-ecco i śrub zamykających ICX-mini	Stal nierdzewna
C-015-100023		Klucz sześciokątny 1,4 mm ręczny krótki 18 mm standardowy do śrub oraz łączników	Stal nierdzewna
C-015-100025		Klucz sześciokątny 1,4 mm ręczny średni 24 mm standardowy do śrub oraz łączników	Stal nierdzewna
C-015-100024		Klucz sześciokątny 1,4 mm ręczny długi 28 mm standardowy do śrub oraz łączników	Stal nierdzewna
C-015-100030		Klucz sześciokątny 1,2 mm ręczny 24 mm do śrub i łączników ICX-multi oraz ICX-Narrow	Stal nierdzewna
C-015-100033		Klucz sześciokątny 1,2 mm na kątnicę do śrub i łączników ICX-multi oraz ICX-Narrow	Stal nierdzewna
C-015-100036		Klucz sześciokątny 1,2 mm ręczny 29 mm do śrub i łączników ICX-multi oraz ICX-Narrow	Stal nierdzewna
C-020-000001		Klucz nasadkowy 3,2 mm do łączników prostych ICX-multi (C-020-7500..)	Stal nierdzewna
C-015-100007		Klucz do montażu łączników kulowych ICX-t-bona	Stal nierdzewna
C-021-000002		Nasadkowy klucz czworokątny 3,75 mm ICX do łączników litych, OCC, śrub rozszerzających oraz przenośnik implantów ICX-WHITE dł. L=25 mm	Stal nierdzewna

ICX
DAS FAIRE
PREMIUM
IMPLANTAT-SYSTEM

Pozostałe narzędzia

Nr artykułu		Artykuł	Materiał
C-015-100009		Klucz kontrowy do implantów ICX mini Zapobiega wykręceniu implantu przy wykręcaniu kuli	Stal nierdzewna
C-014-230315		ICX Parallelpin Ø 2,3/Ø 3,15 mm Pin do sprawdzania równoległości nawierceń	Tytan
C-014-350410		ICX Parallelpin Ø 3,5/Ø 4,1 mm Pin do sprawdzania równoległości nawierceń	Tytan
C-014-006002		Wiertło profilujące ICX Boneprofiler Do przygotowania platformy implantu po gojeniu	Stal nierdzewna
C-015-100016		Linijka kątowa OCC, do 30° 40°	Stal nierdzewna
C-015-100020		Śrubokręt chirurgiczny ICX	Stal nierdzewna

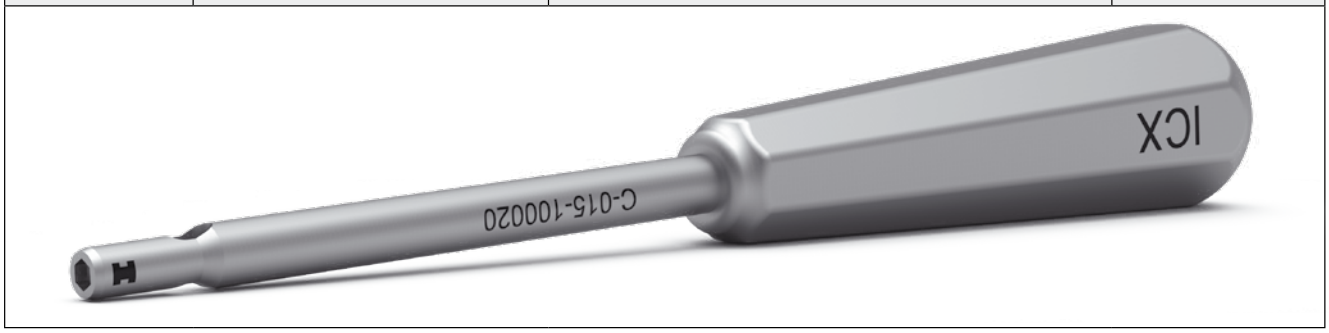

Śruby używane z łącznikami ICX

Nr artykułu		Artykuł	Materiał
C-011-000001-01		Śruba łącząca fioletowa Śruba do większości łączników ICX oprócz: C-007-, C-009-, C-024 oraz ICX-Maximus oraz ICX-multi	Tytan
C-007-000001-01		Śruba łącząca srebrna Dla łączników: C-007-, C-009-, C-024-, zamkniętych transferów wyciskowych	Tytan
C-007-000002-01		Śruba łącząca niebieska, laboratoryjna Do użytku przez technika dentystycznego przy każdym łączniku ICX (oprócz ICX-multi oraz ICX-Maximus) **NIE DO FINALNEGO UŻYCIA**	Tytan
C-020-000011-01		Śruba do łączników protetycznych ICX-multi (tulejka na łączniku multi)	Tytan
C-020-000010-01		Śruba łącząca ICX-multi (łącznik multi z implantem)	Tytan
C-031-000001-01		Śruba łącząca ICX-maximus	Tytan

zamówienia: +48 32 767 55 66 lub sklep.3z.pl

Kaseta protetyczna

Nr artykułu		Artykuł	Materiał
C-015-100005		Ściągacz ICX do zdejmowania mocno osadzonych łączników	Stal nierdzewna
C-015-100007		Przenośnik ICX-t-bona do montażu łączników kulowych	Stal nierdzewna
960001		Klucz dynamometryczny (raczeta) z podziałką 10-45 Ncm	Stal nierdzewna
960007		Adapter uniwersalny (ręczny)	Stal nierdzewna
C-015-100030		Klucz sześciokątny 1,2 mm ręczny 24 mm do śrub i łączników ICX-multi oraz ICX-Narrow	Stal nierdzewna
960002		Klucz sześciokątny 0,9 mm na kątnicę do matryc wewnętrznych T-ecco i śrub zamykających ICX-mini	Stal nierdzewna
C-020-000001		Klucz nasadkowy hex 3,2 mm do łączników prostych ICX-multi	Stal nierdzewna
C-015-100025		Klucz sześciokątny 1,4 mm ręczny średni 24 mm standardowy do śrub oraz łączników	Stal nierdzewna
960004		Uniwersalna przedłużka do wszystkich wierteł UŻYWAĆ Z MOMENTEM OBROTOWYM DO 35 Ncm	Stal nierdzewna
950098		Klucz sześciokątny 1,4 mm długi 28 mm standardowy do śrub oraz łączników	Stal nierdzewna
C-018-000101		Kaseta do sterylizacji (bez zawartości)	Tworzywo
C-018-000102		Kaseta do sterylizacji (wyposażona)	Tworzywo

Zestaw tytanowych tulei stopujących ICX

Nr artykułu	Artykuł	
C-027-129049	Tulejka stopująca ICX Ø 2,9 mm / 4,9 mm BIAŁA ○	**Ø 2,9 mm**
C-027-129065	Tulejka stopująca ICX Ø 2,9 mm / 6,5 mm BIAŁA ○	
C-027-129080	Tulejka stopująca ICX Ø 2,9 mm / 8 mm BIAŁA ○	
C-027-129100	Tulejka stopująca ICX Ø 2,9 mm / 10 mm BIAŁA ○	
C-027-129125	Tulejka stopująca ICX Ø 2,9 mm / 12,5 mm BIAŁA ○	
C-027-135049	Tulejka stopująca ICX Ø 3,45 mm / 4,9 mm ŻÓŁTA ●	**Ø 3,3 mm** **Ø 3,45 mm** Nadaje się również do ICX-NARROW Ø 3,3 mm
C-027-135065	Tulejka stopująca ICX Ø 3,45 mm / 6,5 mm ŻÓŁTA ●	
C-027-135080	Tulejka stopująca ICX Ø 3,45 mm / 8 mm ŻÓŁTA ●	
C-027-135100	Tulejka stopująca ICX Ø 3,45 mm / 10 mm ŻÓŁTA ●	
C-027-135125	Tulejka stopująca ICX Ø 3,45 mm / 12,5 mm ŻÓŁTA ●	
C-027-138049	Tulejka stopująca ICX Ø 3,75 mm / 4,9 mm CZERWONA ●	**Ø 3,75 mm**
C-027-138065	Tulejka stopująca ICX Ø 3,75 mm / 6,5 mm CZERWONA ●	
C-027-138080	Tulejka stopująca ICX Ø 3,75 mm / 8 mm CZERWONA ●	
C-027-138100	Tulejka stopująca ICX Ø 3,75 mm / 10 mm CZERWONA ●	
C-027-138125	Tulejka stopująca ICX Ø 3,75 mm / 12,5 mm CZERWONA ●	
C-027-141049	Tulejka stopująca ICX Ø 4,1 mm / 4,9 mm ZIELONA ●	**Ø 4,1 mm**
C-027-141065	Tulejka stopująca ICX Ø 4,1 mm / 6,5 mm ZIELONA ●	
C-027-141080	Tulejka stopująca ICX Ø 4,1 mm / 8 mm ZIELONA ●	
C-027-141100	Tulejka stopująca ICX Ø 4,1 mm / 10 mm ZIELONA ●	
C-027-141125	Tulejka stopująca ICX Ø 4,1 mm / 12,5 mm ZIELONA ●	
C-027-148049	Tulejka stopująca ICX Ø 4,8 mm / 4,9 mm NIEBIESKA ●	**Ø 4,8 mm**
C-027-148065	Tulejka stopująca ICX Ø 4,8 mm / 6,5 mm NIEBIESKA ●	
C-027-148080	Tulejka stopująca ICX Ø 4,8 mm / 8 mm NIEBIESKA ●	
C-027-148100	Tulejka stopująca ICX Ø 4,8 mm / 10 mm NIEBIESKA ●	
C-027-148125	Tulejka stopująca ICX Ø 4,8 mm / 12,5 mm NIEBIESKA ●	

C-027-000010	Pudełko ICX na tulejki – bez zawartości (starego typu)
C-027-000100	Pudełko ICX na tulejki– zawiera 15 tulejek (starego typu)
C-018-000016	Pudełko ICX na tulejki – bez zawartości
C-018-000017	Pudełko ICX na tulejki– zawiera 25 tulejek

zamówienia: +48 32 767 55 66 lub sklep.3z.pl

Prawidłowy sposób wyjmowania tulei z pudełka

Uwaga: Podczas czyszczenia zwróć uwagę aby tulejki były poukładane ząbkami do góry oraz we właściwej kolejności. Pudełko uniemożliwia zamknięcie gdy tulejki będą źle poukładane (dłuższe w miejscu krótszych).

Szablony implantologiczne

ICX-MAGELLAN

Więcej niż tuleja stopujaca...

zamówienia: +48 32 767 55 66 lub sklep.3z.pl

Modele pokazowe

Model pokazowy all in 1	Model do ćwiczeń endodoncji	Model z plexi + belka
	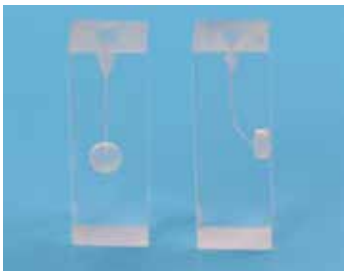	
		BS-PM0010

Model z plexi bezzębie	Model z plexi + analogi	Model z plexi + odbudowa
BS-PM0001	BS-PM0002	BS-PM0003

Model z plexi z zębami	Model z plexi z zębami + analogi	Model z plexi z zębami + odbudowa
BS-PM0004	BS-PM0005	BS-PM0006

Model z plexi z zębami	Model z plexi z zębami + analogi	Model z plexi z zębami + odbudowa
BS-PM0007	BS-PM0008	BS-PM0009

Model z plexi z zębami	Model z plexi z zębami + analogi	Model z plexi z zębami + odbudowa
BS-PM0011	BS-PM0012	BS-PM0013

zamówienia: +48 32 767 55 66 lub sklep.3z.pl

Usługi druku i 3D

Wydrukowany model indywidualny z stl	Przetwarzanie dicom na stl	Wydrukowany model indywidualny z dicom
	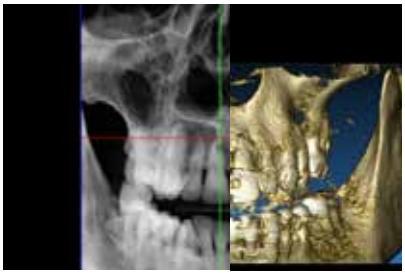	
BS-DM0001		BS-DM0001

Kompletna praca ICX-Imperial	Model + szablon	Model + szablon + szablon redukcyjny
BS-DM0003	BS-DM0004	BS-DM0005

Oprócz druku szablonów implantologicznych oferujemy usługi przetwarzania 3D oraz druku różnych elementów jak np. szablon redukcyjny, proteza drukowana, korony drukowane, praca frezowana w PMMA a także inne usługi we współpracy z Państwa technikiem lub innym zewnętrznym laboratorium protetycznym.

w razie pytań prosimy o kontakt:
magellan@icx.com.pl
kom. 697 301 210

Elementy systemu Magellan

Nr artykułu		Artykuł
C-032-000008 SLV-01		Tulejka stopująca do wierteł Magellan, hex Ø wewn.4,85 mm · Ø zewn. 5,6 mm · Ø kołnierza 6,0 mm
C-032-000001 SLV-02		Tulejka stopująca do wierteł Magellan, okrągła Ø wewn.4,85 mm · Ø zewn. 5,6 mm · Ø kołnierza 6,0 mm
C-032-000002 SLV-03		Tulejka stopująca do pinowania Ø wewn. 1,5 mm · Ø zewn. 2,4 mm · Ø kołnierza 2,8 mm
SLV-05		Uniwersalna tulejka stopująca Ø wewn. 2,2 mm · Ø zewn. 2,95 mm · Ø kołnierza 3,3 mm
C-032-000009		ICX-Magellan krótki pin mocujący do szablonu
C-032-000013		Pin mocujący Ø 1,5 mm
C-032-000016		Przenośnik implantów BL z mikrokulką **TYLKO DLA BONE LEVEL**
C-032-000017		Przenośnik implantów TL z mikrokulką **TYLKO DLA TISSUE LEVEL**
C-032-000020		Wiertło do nawiercania otworów pod piny Ø 1,5 mm
C-032-000021		Wiertło pilotujące nr 1
C-032-000022		Wiertło pilotujące nr 2 L=6,5 mm **NIE DLA ICX-PLUS Ø 3,45 mm**
C-032-000050		Pozycjoner analogów implantów w szablonie **TYLKO DLA BONE LEVEL**
C-032-000051		Pozycjoner analogów implantów w szablonie **TYLKO DLA TISSUE LEVEL**
C-015-100025		Klucz sześciokątny 1,4 mm ręczny średni 24 mm standardowy do śrub oraz łączników
C-032-022110		Wiertło uniwersalne pilotujące Ø 2,2 mm, do 10 mm
C-032-022150		Wiertło uniwersalne pilotujące Ø 2,2 mm, do 15 mm
C-032-000007		Klucz redukcyjny do wiertła Ø 2,0 mm
C-032-020110		Wiertło uniwersalne pilotujące Ø 2,0 mm, do 10 mm

zamówienia: +48 32 767 55 66 lub sklep.3z.pl

PRZYSZŁOŚĆ CYFROWEJ IMPLANTOLOGII

ICX-IMPERIAL

ICX-MAGELLAN + 4 / 6 -ON-ICX + ICX-SMILE BRIDGE

(PROVISORIUM)

Przykręcana proteza tymczasowa od 3 punktowego mostu do 14 punktów.



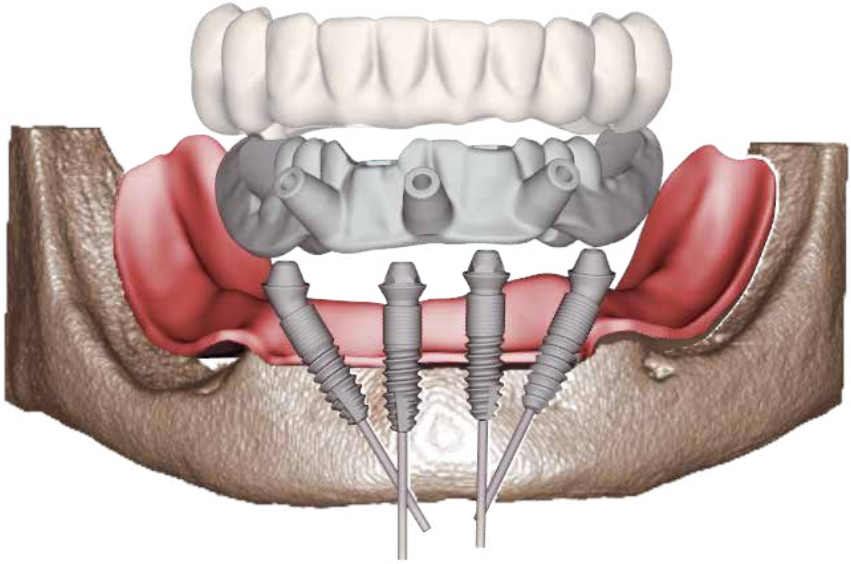

Szablon Implantologiczny + model + proteza tymczasowa

Oferujemy również:

NARZĘDZIA

BIOMATERIAŁY

SZABLONY IMPLANTOLOGICZNE

PIEZOCHIRURGIA

Wyłączny dystrybutor w Polsce:
3Z Sp. z o.o.
41-940 Piekary Śląskie
ul. Wyszyńskiego 85

Zamówienia: *+48 32 767 55 66 / +48 32 767 70 70*
e-mail: *zamowienia@3z.pl*

Wsparcie techniczne: *+48 697 301 210*

Szkolenia: *+48 605 461 012*
e-mail: *akademia@3z.pl*

www.3Z.pl

2021/08 / mm01949